



# DTX Studio™ Implant 3.6

Gebruiksaanwijzing

SUPERSSEDED



**Fabrikant:**

Nobel Biocare AB  
Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17  
Göteborg, Zweden  
Telefoon: +46 31 81 88 00  
Fax: +46 31 16 31 52  
[www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com)



Rx Only

**Licentievrijstelling in Canada:** Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle producten conform de Canadese wetgeving zijn goedgekeurd.

**Enkel op voorschrift te gebruiken. Waarschuwing:** Volgens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een geregistreerde arts of tandarts worden verkocht.

Naam basis-UDI-DI	Basis-UDI-DI
Diagnostische en behandelingssoftware	733274700000016275

GMT 76784 11 oktober 2021 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Alle rechten voorbehouden.

Nobel Biocare, het Nobel Biocare-logo en alle andere handelsmerken die in dit document worden gebruikt, zijn indien niet anders wordt vermeld of aangetoond in een bepaalde context, handelsmerken van Nobel Biocare. iPad® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple® Inc., Adobe® is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft® Corp. Productafbeeldingen in dit document zijn mogelijk niet op schaal.

# Inhoud

<b>Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>Inleiding</b>	<b>8</b>
Afwijzing van aansprakelijkheid	8
Beschrijving van hulpmiddel	8
Beoogd doel	8
Beoogd gebruik/indicaties voor gebruik	9
Beoogde gebruiker en beoogde patiëntendoelgroep	9
Vereiste compatibiliteit met andere instrumenten	9
Instrumenten met meetfunctie	9
Contra-indicaties	9
Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen	9
Algemene voorzorgsmaatregelen	9
Waarschuwingen	10
Waarschuwingen	10
Cyberbeveiliging	11
Compatibiliteit	11
Interoperabiliteit	11
Beoogde levensduur	11
Prestatievereisten en beperkingen	11
Klinische voordelen en ongewenste bijwerkingen	11
Faciliteiten en training	11
Opmerking betreffende ernstige incidenten	11
Aanvullende informatie	11
<b>Start</b>	<b>12</b>
Het behandelconcept	12
DTX Studio™ Implant openen	12
Basishandelingen met patiëntbestanden	12
Een nieuw patiëntbestand maken	12
Een bestaand patiëntbestand openen	12
Een behandelplan openen	12
Een behandelplan opslaan	12
Een behandelplan kopiëren	12
De naam van een behandelplan wijzigen of een behandelplan verwijderen	12
Een behandelplan sluiten	12
Een patiëntbestand sluiten	13
Een patiëntbestand archiveren	13

<b>Gebruikersidentificatie</b>	<b>14</b>
Aanmelden	14
Twee-factor-authenticatie	14
Omschakelen tussen gebruikers	14
Accountgegevens beheren	14
<b>Praktijksysteem</b>	<b>15</b>
Praktijksysteem installeren	15
Accounts beheren	15
Gebruikers toevoegen	15
<b>Softwareoverzicht</b>	<b>16</b>
Werkgebiedsysteem	17
Wat is een werkgebied?	17
Taakbalk	17
Interactie met de viewers	18
Objecten manipuleren	19
Een object weergeven of verbergen	19
Een CT-snede manipuleren	20
Door CT-beelden bladeren	20
Level en window	20
Level/window bij 2D	20
Level/window bij 3D	20
<b>Patiëntmodel</b>	<b>21</b>
Een 3D-patiëntmodel maken	21
De vorm van de reslicecurve bewerken	21
De bestaande Besturingspunten bewerken	21
Tandbesturingspunten gebruiken	21
De grootte van de dwarsdoorsnede van de reslice aanpassen	22
Visualisatie van het patiëntmodel	22
Wat is een overdrachtsfunctie?	22
De visualisatie van het Patiëntmodel opschonen	22
Beeld bijwerken	22
Botartefacten verwijderen	23
Bijgewerkt beeld uitschakelen	23
Bijgewerkt beeld resetten	23
Grootste gedeelte behouden	23
<b>Prothetische informatie</b>	<b>24</b>
Diagnostische opstelling	24
Optische scan	24
Een scan van het gietmodel	24
Intraorale scan of een scan met een andere desktopscanner	24

SmartFusion™	25
De optische scan toevoegen aan het patiëntmodel	25
Initialisatie van SmartFusion™	26
Initialisatieprocedure	26
De initialisatiewizard starten	27
Overeenkomende punten in de wizard definiëren	27
Aangezichtsscan	29
Een optische scan toevoegen aan het patiëntmodel	29
Een aangezichtsscan bijsnijden	29
SmartSetup™	29
Een SmartSetup™ berekenen	29
SmartSetup™ -instellingen	30
Een SmartSetup™ bewerken	30
Model voor scanprothese	31
Gingiva-oppervlak	31
<b>Diagnosticeren</b>	<b>32</b>
Zenuwen	32
Tanden	32
Tanden uit het model verwijderen	32
Alle tanden tegelijkertijd verwijderen	32
Eén tand/kies trekken	33
Metingen	33
<b>Implantaten plannen</b>	<b>34</b>
Werken met implantaten van andere fabrikanten dan Nobel Biocare	34
Een implantaat toevoegen aan een behandelplan	34
Wat betekent de gele zone?	35
Tandpositie	35
Tandenkaart	35
Een implantaat manipuleren	35
De oriëntatie van een implantaat wijzigen	35
Een implantaat verplaatsen	35
Implantaten parallel zetten	36
Een parallel implantaat plaatsen	36
Alle implantaten parallel plaatsen	36
Abutments	36
Het chirurgietype instellen	36
Verschillende chirurgietypen	37
Verschuiving pilot sleeve	37
Rotatie pilot sleeve	38
Botkamreductie	38

Ankerpinnen	39
Een ankerpin toevoegen aan het behandelplan	39
Juiste inclinatie en diepte van ankerpinnen	39
Ankerpinnen en scanprothese (behandelstappen in edentate situaties)	40
Ankerpinnen en optische scan (behandelstappen in gedeeltelijk edentate situaties)	41
<b>Een behandelplan inspecteren</b>	<b>42</b>
Werken met de klikfunctionaliteit	42
Naar een ander implantaat of een andere ankerpin springen	42
Teruggaan naar de boogmodus	42
<b>Voltooien</b>	<b>43</b>
Een chirurgische boormal maken	43
De chirurgische boormal inspecteren	43
De virtuele chirurgische boormal bewerken	44
Een behandelplan goedkeuren	44
<b>Bestellingen</b>	<b>45</b>
Werken met connecties	45
Een connectie toevoegen	45
Een connectie accepteren	45
Werken met bestellingen	45
Productbestellingen	45
Een productbestelling maken	45
Een productbestelling verzenden	46
Modelscanbestellingen	46
Een modelscanbestelling maken	46
TempShell -bestellingen	46
De TempShell-behandelstappen	46
Een LabDesign-aanvraag maken	47
Een TempShell-bestelling maken	47
Een LabDesign toevoegen aan het behandelplan	47
Een TempShell toevoegen aan het behandelplan	47
Serviceaanvragen	48
De gangbare behandelstappen voor de serviceaanvraag via DTX Studio™ Go	48
Reageren op een serviceaanvraag	48
De 'lokale' behandelstappen voor de serviceaanvraag	48
<b>Werken met de DTX Studio™ Implant Assistent</b>	<b>49</b>
<b>DTX Studio™ Implant-waarschuwingssysteem</b>	<b>50</b>
DTX Studio™ Implant-waarschuwingen	51
Boormalwaarschuwingen	51

Klinische waarschuwingen	52
Algemene waarschuwingen	52
Implantaatwaarschuwingen	53
Configureerbare waarschuwingen	53
Technische beperkingen	54
Minimale afstand tussen guided sleeves	54
Minimale afstand tussen guided sleeves en implantaten of guided sleeves en ankerpinnen	54
Contact tussen implantaten, ankerpinnen, of implantaten en ankerpinnen	54
Verhouding tussen guided sleeve en scanprothese en/of optische scan	55
Scanprothese	55
Een scan van het gietmodel	55
Verhouding tussen guided sleeve en bot	56
Guided abutments	56
Scanprothese is gemaakt zonder gekalibreerde isowaarde	56
<b>Het behandelplan bespreken</b>	<b>57</b>
Rapporten	57
Een rapport maken	57
Een rapport afdrukken	57
Viewerbestanden	58
Een viewerbestand maken	58
Een viewerbestand openen via DTX Studio™ Implant	58
Een viewerbestand openen via de downloadlink	58
Communicator-presentaties	59
Een Communicator-presentatie maken	59
<b>Een behandelplan voor consulten of chirurgie exporteren</b>	<b>60</b>
Exporteren naar DTX Studio™ Clinic	60
3D-plan exporteren	60
X-Guide™ -chirurgieplan	60
Een X-Guide™ -chirurgieplan maken	60
Een X-Guide™ -chirurgieplan exporteren	60
OsseoCare™ Pro Chirurgieplan	61
Een OsseoCare™ Pro-chirurgieplan maken	61
<b>Scannerkalibratie</b>	<b>62</b>
Een nieuwe kalibratieset maken	62
<b>Verklarende symbolenlijst</b>	<b>63</b>
<b>Index</b>	<b>64</b>

# Inleiding

## AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit product maakt deel uit van een veelomvattend concept en mag alleen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende originele producten volgens de instructies en aanbevelingen van Nobel Biocare. Als u producten van andere fabrikanten op niet-aanbevolen wijze gebruikt in combinatie met producten van Nobel Biocare, vervallen alle garanties en andere verplichtingen, expliciet of impliciet, van Nobel Biocare. Het is de plicht van de gebruiker van producten van Nobel Biocare om te bepalen of een bepaald product al dan niet geschikt is voor de specifieke patiënt en de omstandigheden. Nobel Biocare wijst elke aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet. Nobel Biocare wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of andere schade die het gevolg is van professionele beoordelingsfouten of uitvoeringsfouten bij het gebruik van producten van Nobel Biocare. De gebruiker is tevens verplicht om de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot dit product van Nobel Biocare en de toepassingen daarvan regelmatig te bestuderen. Bij twijfel moet de gebruiker contact opnemen met Nobel Biocare. Aangezien dit product door de gebruiker wordt gebruikt, valt dit gebruik onder de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Nobel Biocare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade hieruit voortkomend. Sommige producten die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn mogelijk niet reglementair goedgekeurd, uitgebracht of voor de verkoop goedgekeurd op alle markten.

**Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u DTX Studio™ Implant gaat gebruiken en bewaar die gebruiksaanwijzing als naslagwerk. De informatie in dit document is bedoeld om u op weg te helpen.**

## BESCHRIJVING VAN HULPMIDDEL

DTX Studio™ Implant is software voor klinisch gebruik voor de ondersteuning van het op beelden gebaseerde diagnostische proces en behandelplannen voor dentale, craniomaxillofaciale en gerelateerde behandelingen. Om het proces van diagnostiek en behandelplannen voor tandheelkundige, craniomaxillofaciale en gerelateerde behandelingen te ondersteunen, biedt DTX Studio™ Implant een visualiseringstechniek voor (CB) CT-beelden van de patiënt. Daarnaast kunnen ook 2D-beeldgegevens, zoals foto's en röntgenfoto's of oppervlaktescans van de intraorale situatie, worden gevisualiseerd om alle diagnostische beeldgegevens samen te voegen. Ook kunnen prothetische gegevens worden toegevoegd en gevisualiseerd voor de ondersteuning van de planning van implantaten. Het chirurgieplan, inclusief de implantaatposities en de prothetische gegevens, kan worden geëxporteerd voor het ontwerpen van tandheelkundige restauraties in DTX Studio™ Lab.

DTX Studio™ Implant ondersteunt het klinische NobelGuide®-concept voor orale rehabilitatie op basis van implantaten. Het maakt deel uit van het complete Guided Surgery-systeem ('NobelGuide®-concept') voor de behandeling van gedeeltelijk en volledig edentate kaken, waaronder casussen waarin een enkele tand ontbreekt.

Gebruikers van DTX Studio™ Implant kunnen ervoor kiezen zich in te schrijven voor regelmatige trainings- en voorlichtingssessies om zich de planningssoftware eigen te maken. Raadpleeg de cursussen die beschikbaar zijn via de website van Nobel Biocare op [www.nobelbiocare.com](http://www.nobelbiocare.com) voor meer informatie.

## BEOOGD DOEL

Het beoogde doel van de software is het bieden van ondersteuning bij diagnostiek en behandelplanning voor dentale en craniomaxillofaciale behandelingen.



## BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES VOOR GEBRUIK

DTX Studio™ Implant is een software-interface voor de overdracht en visualisatie van 2D- en 3D-beeldinformatie afkomstig van apparatuur zoals een CT-scanner, voor het ondersteunen van het diagnostische proces, de behandelplanning en de follow-up in de dentale en craniomaxillofaciale gebieden.

DTX Studio™ Implant kan worden gebruikt voor de ondersteuning van guided implantchirurgie en voor ontwerpinformatie voor en de beoordeling van dentale restauratieve oplossingen. De resultaten kunnen worden geëxporteerd voor de vervaardiging van de restauratieve oplossing.

## BEOOGDE GEBRUIKER EN BEOOGDE PATIËNTENDOELGROEP

DTX Studio™ Implant wordt gebruikt om een interdisciplinair team te ondersteunen bij het uitvoeren van dentale, craniomaxillofaciale of gerelateerde behandelingen op patiënten.

Bestemd voor patiënten die een tandbehandeling ondergaan.

## VEREISTE COMPATIBILITEIT MET ANDERE INSTRUMENTEN

- DTX Studio™ Implant Viewer-software
- NobelClinician Communicator iPad-app
- OsseoCare™ Pro iPad-app
- DTX Studio™ Lab
- DTX Studio™ Implant moet compatibel zijn met de meest gebruikte besturingssystemen Windows en Mac, inclusief de nieuwste versies.
- X-Guide™ – 3D-navigatiesysteem (X-Nav Technologies, LLC)
- DTX Studio™ Clinic
- NobelGuide®-concept en chirurgische boormal
- Implantaten en confectieabutments van Nobel Biocare
- Voor het importeren van oppervlakgegevens in DTX Studio™ Implant: oppervlaktescan verkregen via NobelProcera® 2G-scanner, Kavo LS 3-scanner. Versleuteld formaat (\*.nxa)
- Implantaten van derden voor behandelplanning en guided surgery – alleen pilotboren.
- DICOM-import (van (CB)CT-scanners) en STL/PLY-import (van desktop- of intraorale scanners).
- DTX Studio™ Implant moet compatibel zijn met het online portal – DTX Studio™ Go.

## INSTRUMENTEN MET MEETFUNCTIE

Hoe nauwkeurig een meting is, hangt af van de beeldgegevens, de gebruikte scannerhardware, de kalibratie-instellingen en de instellingen voor de optische scan. De meting kan niet preciezer zijn dan de resolutie van het beeld. Door de DTX Studio™ Implant-software wordt de waarde gerapporteerd en afgerond op één cijfer achter de komma, gebaseerd op door de gebruiker gekozen punten.

## CONTRA-INDICATIES

Geen contra-indicaties bekend voor DTX Studio™ Implant.

## WAARSCHUWINGEN/VOORZORGSMATREGELEN

### Algemene voorzorgsmaatregelen

- Pas een nieuw instrument of een nieuwe behandelmethode de eerste keer altijd toe in aanwezigheid van een ervaren collega om mogelijke complicaties te vermijden. U kunt hiervoor gebruik maken van het wereldwijde mentornetwerk van Nobel Biocare.
- Honderd procent succes kan niet worden gegarandeerd bij implantaten. Vooral het niet volgen van de instructies voor gebruik van het product en het niet volgen van de chirurgische of behandelings-procedure(s) kan leiden tot verkeerde resultaten. Bij kinderen wordt deze routinebehandeling niet aangeraden voordat definitief is vastgesteld dat de groeifase van het kaakbot is voltooid.

- Onvoldoende hard of zacht weefsel vóór de chirurgie kan een minder mooi esthetisch resultaat of een ongunstige hoek van het implantaat opleveren. Het is sterk aan te raden om NobelGuide® chirurgische boormallen en duplicaten van gebitsprothesen uitsluitend te gebruiken met de juiste Nobel Biocare-implantaten, chirurgische instrumenten en prothetische componenten. Het combineren van componenten die niet bedoeld zijn om samen te gebruiken, kunnen leiden tot technische fouten of defecten aan instrumenten, weefselschade of ongewenste esthetische resultaten.
- De gebruiker van Nobel Biocare-implantaten heeft de verantwoordelijkheid om vóór het plannen van een extraorale chirurgische procedure, dus craniomaxillofaciale behandeling met tandheelkundige implantaten buiten het tandheelkundige of zygomatische gebied, vast te stellen of een implantaat wel of niet is bedoeld voor extraoraal gebruik.
- Opmerking: In de Verenigde Staten en een aantal andere markten is de fysieke chirurgische boormal voor enossale tandheelkundige implantatie een medisch instrument. Neem contact op met uw lokale regulerende instantie voor meer informatie over de wettelijke statussen en vereisten met betrekking tot de productie van deze chirurgische sjablonen.

### Waarschuwingen

- Wanneer waarschuwingen worden geactiveerd vanwege de cilindervormen, worden deze waarschuwingen berekend op basis een schatting van de productvorm.
- Producten die niet beschikbaar zijn, worden weergegeven met een rode waarschuwing in het venster Productselectie en worden blauw weergegeven in de 3D-weergave. Deze producten kunnen niet worden besteld.

### WAARSCHUWINGEN



- Dit planningsprogramma controleert niet automatisch alle technische beperkingen! In sommige gevallen kunnen de chirurgische sjablonen zelfs niet worden geproduceerd als technische beperkingen niet automatisch worden aangegeven via de software.
- De gebruiker moet vertrouwd zijn met de interpretatie van CT-gegevens en de manier waarop CT-gegevens worden gevisualiseerd met behulp van volumerendering.
- Onjuiste uitlijning van de CBCT-scan en de oppervlaktescan zorgt voor een onjuiste chirurgische boormal die waarschijnlijk niet kan worden gebruikt bij de chirurgische ingreep.
- Houd er rekening mee dat er verschillen in de visualisatie van de gegevens (bijv. viewerstand, kleuren van het object) evenals verschillende waarschuwingen kunnen zijn tussen de DTX Studio™ Implant- en de X-Guide™-software.
- Scanwaarschuwingen:

---

De DICOM-dataset bevat minder dan twee slices.

---

De DICOM-dataset bevat een slice increment van nul.

---

De DICOM-dataset bevat inconsistente snedeverhogingen.

---

De DICOM-dataset heeft geen beeldoriëntatie.

---

De DICOM-dataset heeft een verkeerde beeldoriëntatie.

---

De slicedikte van de DICOM-dataset is te groot.

---

De DICOM-dataset heeft een gantry detector tilt.

---

De snedeverhoging van de DICOM-dataset is te groot  
(deze DICOM-dataset kan worden gebruikt, maar wel op eigen klinisch risico).

---



## CYBERBEVEILIGING

Het wordt aanbevolen dat u actieve en bijgewerkte antivirus- en antimalwaresoftware en een correct geconfigureerde firewall hebt geïnstalleerd op de computer waarop u DTX Studio™ Implant wilt gebruiken. Sluit de computer bovendien af als u deze onbeheerd achterlaat.

## COMPATIBILITEIT

DTX Studio™ Implant is niet verbonden met andere medische instrumenten. De software is compatibel met eerdere versies van DTX Studio™ Implant.

## INTEROPERABILITEIT

DTX Studio™ Implant is compatibel met DTX Studio™ Clinic en DTX Studio™ Lab.

## BEOOGDE LEVENSDUUR

De beoogde levensduur van de software is onbeperkt, en als deze op de ondersteunde besturingssystemen wordt gebruikt, kan de software gebruikt blijven worden voor de doelen waarvoor deze bestemd is.

## PRESTATIEVEREISTEN EN BEPERKINGEN

DTX Studio™ Implant is afhankelijk van de besturingssystemen waarop het wordt gebruikt. Het is daarom van belang dat u erop let dat DTX Studio™ Implant alleen wordt gebruikt met goedgekeurde besturingssystemen. Zie de Computerrichtlijnen voor DTX Studio™ Implant voor meer informatie over de besturingssystemen die zijn goedgekeurd.

## KLINISCHE VOORDELEN EN ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

DTX Studio™ Implant maakt deel uit van de behandeling voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten en/of kronen en bruggen. Het klinische voordeel dat patiënten van deze behandeling kunnen verwachten is dat hun ontbrekende tanden worden vervangen en/of hun kronen hersteld.

Geen bijwerkingen bekend.

## FACILITEITEN EN TRAINING

Het is sterk aan te raden dat artsen, zowel onervaren als ervaren gebruikers van tandheelkundige implantaten, tandprothesen en bijbehorende software, te allen tijde een speciale training volgen alvorens met een nieuwe behandelmethode te beginnen. Nobel Biocare biedt een breed scala aan cursussen op diverse kennis- en ervaringsniveaus aan. Zie [nobelbiocare.com](https://www.nobelbiocare.com) voor meer informatie.

## OPMERKING BETREFFENDE ERNSTIGE INCIDENTEN

Als er tijdens het gebruik van dit instrument of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet dit aan de fabrikant en aan de toepasselijke nationale autoriteit worden gemeld. De contactgegevens van de fabrikant van dit hulpmiddel waar een ernstige incident moet worden gemeld, is als volgt:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

## AANVULLENDE INFORMATIE

Voor meer informatie over het NobelGuide®-concept en de chirurgische procedures raadpleegt u een Nobel Biocare-vertegenwoordiger. DTX Studio™ Implant-prestaties zijn afhankelijk van de gebruikte besturingssystemen. Gebruik DTX Studio™ Implant daarom alleen met goedgekeurde besturingssystemen. Neem contact op met de klantondersteuning voor meer informatie over de goedgekeurde besturingssystemen en hoe u DTX Studio™ Implant moet installeren.


# Start

## HET BEHANDELCONCEPT

Een **behandeling** omvat alle **behandelplannen** betreffende een patiënt. Er kan een nieuwe behandeling worden gestart wanneer een nieuwe patiënt wordt gemaakt of wanneer u met een bestaande patiënt werkt. U kunt, bijvoorbeeld, afzonderlijke behandelingen opstellen voor de boven- en de onderkaak.

Een **behandelplan** bevat een basispatiëntmodel, optische scan, waspas en/of scanprothese evenals de producten in de huidige weergaveconfiguratie van een bepaalde patiënt.

## DTX STUDIO™ IMPLANT OPENEN

U kunt DTX Studio™ Implant openen door te dubbelklikken op het -pictogram op het bureaublad. De software wordt geopend in de kantoormodule, waarna u zich kunt aanmelden en aan uw patiëntbestanden kunt gaan werken.

## BASISHANDELINGEN MET PATIËNTBESTANDEN

**Opmerking:** Meld u aan bij DTX Studio™ Implant om aan patiëntbestanden te kunnen werken.

### Een nieuw patiëntbestand maken

Om een nieuw patiëntbestand te maken, klikt u op **Nieuw**  op het tabblad **Medische dossiers** op de taakbalk. Geef in het dialoogvenster **Nieuwe patiënt** aan of u een 3D-patiëntmodel wilt maken, een scan of een gietmodel wilt bestellen of patiëntgegevens wilt invoeren.

### Een bestaand patiëntbestand openen

Als u een bestaand patiëntbestand wilt openen, dubbelklikt u op een patiëntnaam in de lijst. Het dialoogvenster **Medisch dossier** wordt weergegeven, waarin u kunt aangeven of u naar de module wilt gaan om een 3D-plan te maken, patiëntgegevens wilt invoeren, producten wilt bestellen of een behandelplan wilt bespreken.


### Een behandelplan openen

Wanneer een specifiek patiëntbestand is geopend en u een behandelplan voor die patiënt wilt openen, klikt u op het tabblad **DTX Studio Implant** op de taakbalk en klikt u op **Openen** . Wanneer het venster **Planningoverzicht** wordt weergegeven, selecteert u het behandelplan en klikt u op **Scenario openen**.

### Een behandelplan opslaan

U slaat een behandelplan op met **Opslaan**  op het tabblad **DTX Studio Implant** of door op [Ctrl+S] te drukken.


### Een behandelplan kopiëren

Als u een kopie van de behandeling wilt opslaan, bijvoorbeeld om een behandeling te maken voor de tegenoverliggende kaak met behulp van een kopie van de gegevens, kiest u **Opslaan als** op het tabblad **DTX Studio Implant** en selecteert u **Nieuwe behandeling** .

### De naam van een behandelplan wijzigen of een behandelplan verwijderen

U hernoemt of verwijdert een behandelplan door te klikken op de optie **Beheren** op het tabblad **DTX Studio Implant**. Dit is alleen mogelijk wanneer er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.


### Een behandelplan sluiten

U sluit een behandelplan door op het tabblad **DTX Studio Implant** op de taakbalk te klikken en vervolgens op **Plan sluiten**  te klikken. Het behandelplan wordt gesloten en het dialoogvenster **Planningoverzicht** wordt weergegeven.

### Een patiëntbestand sluiten

U sluit een patiëntbestand door te klikken op het tabblad **DTX Studio Implant** op de taakbalk en in het menu de optie **Patiënt sluiten** te kiezen. Wanneer het dialoogvenster **Medische dossiers** wordt weergegeven, klikt u op **Patiënt sluiten**. Als er nog niet-opgeslagen wijzigingen in het patiëntbestand staan, verwacht het systeem een actie: **Opslaan**, **Niet opslaan** of **Annuleren** van het sluiten van een patiëntbestand.

### Een patiëntbestand archiveren


Als u patiëntbestanden naar het archief wilt verplaatsen, klikt u op **Archiveren**  op het tabblad **Medische dossiers**.

SUPERSEDED

# Gebruikersidentificatie

Meerdere gebruikers kunnen gebruikmaken van de computer met DTX Studio™ Implant. Om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers zich kunnen aanmelden bij DTX Studio™ Implant en die gebruiken, is de juiste gebruikersidentificatie vereist. De software zal de juiste gebruikersinstellingen en patiëntprivacyregels toepassen. Er kan twee-factor-authenticatie worden ingesteld via DTX Studio™ Go om de beveiliging nog verder te vergroten.

## AANMELDEN

1. Dubbelklik het pictogram  op het bureaublad om de software te openen.
2. Selecteer de gebruiker.
3. Voer het bijbehorende wachtwoord in.
4. Klik op **Aanmelden**.

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, voert u het wachtwoord in dat u in de registratie-e-mail hebt ontvangen. Wijzig, zoals gevraagd, het wachtwoord. Het wachtwoord moet zo veilig en sterk mogelijk zijn en mag geen voor de hand liggende bewoordingen bevatten (bijvoorbeeld, verwijzing naar persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, enzovoort).

Als u **Automatisch aanmelden** selecteert, zal het dialoogvenster voor aanmelden bij DTX Studio™ Implant niet meer worden weergegeven op die computer.

## Twee-factor-authenticatie

Als er twee-factor-authenticatie is ingesteld in DTX Studio™ Go, moet u een wachtwoord en een uit zes cijfers bestaande verificatiecode invoeren om u aan te melden. U wordt gevraagd om elke 30 dagen een nieuwe, uit zes cijfers bestaande verificatiecode op te geven.

## OMSCHAKELEN TUSSEN GEBRUIKERS

In DTX Studio™ Implant kunt u tussen gebruikers schakelen door te klikken op **Wisselen van account** in het **DTX Studio Implant**-menu in de module **Mijn kantoor**.

## ACCOUNTGEGEVENS BEHEREN

Als u licentie- of accountgegevens wilt raadplegen, gegevens wilt bewerken of een wachtwoord wilt wijzigen, connecties of machtigingen in een praktijk wilt beheren, opent u het dialoogvenster **Account beheren**:

1. Klik op het tabblad **DTX Studio Implant** in de module **Mijn kantoor**.
2. Selecteer **Accounts beheren**.
3. In het dialoogvenster **Account beheren** worden de beschikbare gegevens weergegeven.

# Praktijksysteem

Met de praktijksysteemversie van DTX Studio™ Implant zijn meerdere installaties en aanmeldingen van meerdere gebruikers in een tandartspraktijk mogelijk. U kunt hiermee patiëntbestanden centraal opslaan in een gedeelde netwerkmap met gemakkelijke toegang tot deze bestanden vanaf verschillende locaties.

## PRAKTIJKSYSTEEM INSTALLEREN

Voor instructies over de installatie en registratie van DTX Studio™ Implant neemt u contact op met klantenondersteuning.

## ACCOUNTS BEHEREN

Voor het beheren van de gebruikersaccounts die beschikbaar zijn in een praktijk, en het instellen van de bijbehorende gebruikersmachtigingen opent u het dialoogvenster **Accounts beheren** via de optie **Account beheren** in het **DTX Studio Implant**-menu.


## GEBRUIKERS TOEVOEGEN

Als u nieuwe gebruikers wilt toevoegen, neemt u contact op met de klantenservice of helpdesk van Nobel Biocare.

SUPERSEDED

# Softwareoverzicht

De voornaamste onderdelen van de grafische gebruikersinterface worden weergegeven in de afbeelding hieronder.

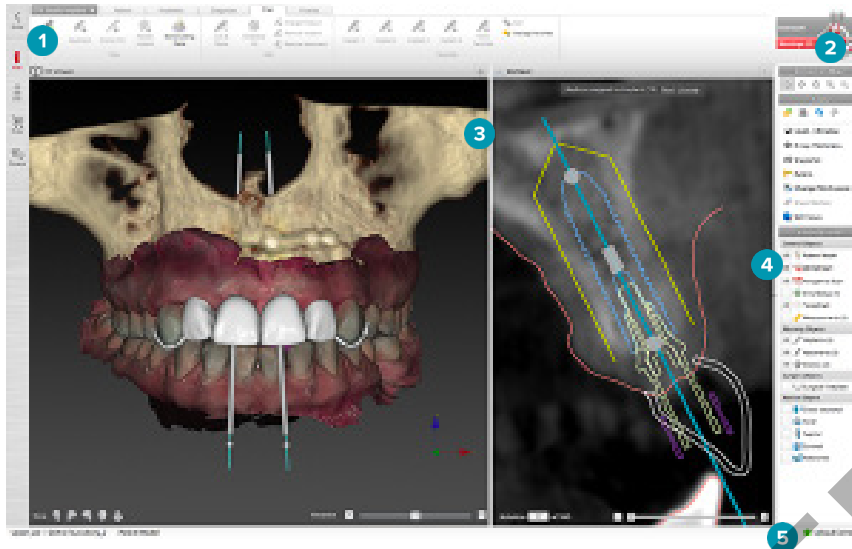

- 1 taakbalk met opdrachtgroepen die specifiek zijn voor de geselecteerde module
- 2 Assistent
- 3 Werkgebied
- 4 Modulebalk
- 5 Upload Center

Klik op de pictogrammen in de modulebalk om door de verschillende DTX Studio™ Implant-modules te navigeren:

	<b>Start/Mijn kantoor</b> -module voor het beheren van patiënten en kalibratiesets.
	<b>3D-planning</b> -module voor het importeren van DICOM-bestanden, voor het maken van patiëntmodellen en boormallen, voor diagnostiek en planning.
	<b>Patiëntinformatie</b> -module voor opslag van patiëntinformatie en beheer van klinische afbeeldingen in de <b>Patiëntbibliotheek</b> .
	<b>Bestel</b> -module voor het bestellen van het gietmodel of de waspas, TempShells of de chirurgische boormal en het duplicaat van de gebitsprothese samen met gestandaardiseerde componenten.
	<b>Overleg</b> -module voor het vergemakkelijken van de communicatie over een behandelplan met collega's en patiënten door middel van viewerbestanden, rapporten en/of Communicator-presentaties, en voor het koppelen van DTX Studio™ Implant en OsseoCare™ Pro met behulp van het opstellen van OsseoCare™ Pro-ingrepen.

Dubbelklik op een patiënt in **Mijn kantoor** om naar het specifieke gedeelte voor die patiënt te gaan. Klik op **3D-planning** voor het diagnosticeren en plannen van een behandeling.




## WERKGEBIEDSYSTEEM


Wanneer u een planning maakt in DTX Studio™ Implant, is het belangrijk om de patiëntgegevens op diverse manieren te bekijken. De vereiste weergave hangt af van welke gegevens de gebruiker nodig heeft. Deze verschillende weergaven van gegevens worden werkgebieden genoemd.

### WAT IS EEN WERKGEBIED?

Een werkgebied is de schikking van 3D- en 2D-viewers in combinatie met de editordeelvensters op de zijbalk rechts van het scherm. Een werkgebied laat u toe om 3D-objecten en/of 2D-beelden te visualiseren en uit te wisselen. U kunt schakelen tussen de verschillende viewerindelingen die in het systeem beschikbaar zijn om de pre-operatieve beeldgegevens te bekijken.

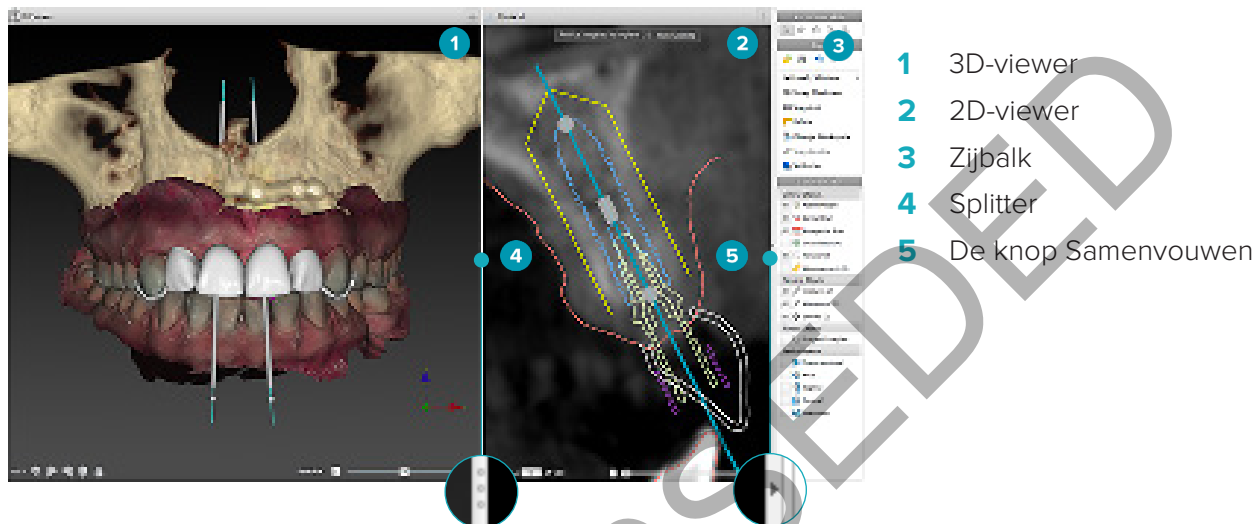



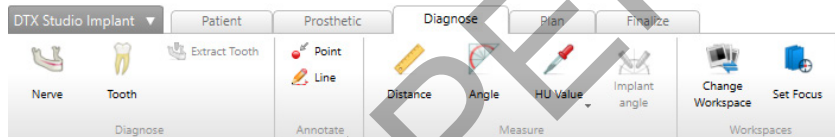


## TAAKBALK



Boven aan het werkgebied kunt u in een contextgevoelige taakbalk de hulpmiddelen openen die u voor bepaalde taken nodig hebt. In de planningsmodule verschijnen speciale tabbladen voor selectie van specifieke objecten (bijvoorbeeld dwarsdoorsnede van reslice, implantaten, enzovoort). Via deze speciale tabbladen, ook wel contexttabbladen genoemd, hebt u alternatieve toegang tot acties die ook beschikbaar zijn via de pop-upmenu's die verschijnen wanneer u met de rechtermuisknop op een object klikt.

## INTERACTIE MET DE VIEWERS

U kunt voor de interactie met 3D-modellen kiezen uit verschillende modi. Wissel tussen deze interactiemodi door op de pictogrammen in de taakbalk Interactie te klikken, via een menu dat u opent door met de rechtermuisknop op **Interactie** te klikken, of via een combinatie van sneltoetsen.

	Interactiemodus	Selecteer of identificeer een object voor een actie door op de linkermuisknop te drukken.
	Rotatiemodus	Draai de 3D-weergave (alleen 3D) door de muis te verslepen.
	Panmodus	Neem de weergave vast en verplaats ze door de muis te verslepen.
	Zoommodus	Zoom in of uit door de muis te verslepen.
	Zoomkadermodus	Inzoomen op een specifiek deel van het model door een rechthoekig gebied te tekenen (alleen in 2D).






Wissel tussen de verschillende interactiemodi met behulp van de sneltoetsen:

Ctrl (Cmd) of middelste muisknop	Schakel naar panmodus als u in een andere modus bezig bent. Zolang de toets wordt ingedrukt, blijft de Panmodus actief. Laat de toets los om naar de oorspronkelijke modus terug te keren.
Alt	Schakel naar Rotatiemodus als u in een andere modus bezig bent. Zolang de toets wordt ingedrukt, blijft de Rotatiemodus actief. Laat de toets los om naar de oorspronkelijke modus terug te keren.
Shift	Schakel naar Zoommodus als u in een andere modus bezig bent. Zolang de toets wordt ingedrukt, blijft de Zoommodus actief. Laat de toets los om naar de oorspronkelijke modus terug te keren.
Tab-toets	Wisselen tussen Interactiemodus en Rotatiemodus.

In de 3D-viewer zijn verschillende standaardaanzichten beschikbaar.



Klik op de pictogrammen om naar de bijbehorende standaardaanzichten van het model te gaan.

	Voor – Standaardvooraanzicht – sneltoets [5]
	Links – Standaard lateraal aanzicht links – sneltoets [1]
	Rechts – Standaard lateraal aanzicht rechts – sneltoets [3]
	Boven naar onder – Standaard cranio-caudaal aanzicht – sneltoets [9]
	Boven naar onder – Standaard caudo-caudaal aanzicht – sneltoets [7]

## OBJECTEN MANIPULEREN

1. Om een object te selecteren, opent u de interactiemodus en klikt u op het object. In een 3D-viewer geeft een witte contourlijn aan dat het object is geselecteerd. In een 2D-viewer is de omtrek van het geselecteerde object gekleurd.

**Opmerking:** het patiëntmodel is in dit geval een uitzondering. Wanneer het patiëntmodel is geselecteerd, wordt er geen contourlijn weergegeven.

2. Selecteer de dwarsdoorsnede van de reslice, een implantaat of een ankerpin en krijg toegang tot daarmee verband houdende acties via het speciale taakbalktabblad.
3. Klik met de rechtermuisknop op een object om het pop-upmenu met aan dat object gerelateerde acties weer te geven.


## EEN OBJECT WEERGEVEN OF VERBERGEN




Voor een efficiënte planning van de behandeling voor een patiënt is het belangrijk dat tijdens de planningsfase alleen de objecten worden weergegeven die van belang zijn.

Een enkel object kan worden verborgen met het menu dat u opent door op de rechtermuisknop te klikken of met sneltoets [H].

Met de **Weergave-editor** kunt u de weergave van de standaardobjecten in- of uitschakelen met één klik op de muisknop.

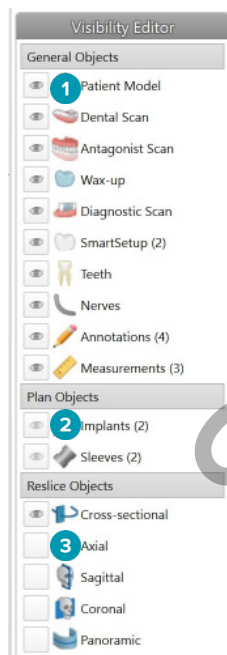Voor groepsobjecten zijn verschillende weergavepictogrammen beschikbaar:



- 1 Als het zwarte weergavepictogram  vóór de groep wordt weergegeven, worden alle objecten in die groep weergegeven.
- 2 Als het grijze weergavepictogram  vóór de groep wordt weergegeven, zijn één of meer objecten in de groep verborgen terwijl andere wel worden weergegeven.
- 3 Als er vóór de groep geen pictogram wordt weergegeven , zijn alle objecten in die groep verborgen.

## EEN CT-SNEDE MANIPULEREN

### Door CT-beelden bladeren

DTX Studio™ Implant is voorzien van een aantal hulpmiddelen, zoals een muis met een bladerwiel, de schuifbalk of het snede-invoerveld om door de sneden te bladeren.

### LEVEL EN WINDOW

Gebruik het level/window-instrument bij zowel 2D- als 3D-viewers om het level en het window te wijzigen van de waarden die worden gebruikt om gegevens te converteren in een afbeelding of model. Het resultaat verschilt afhankelijk van het type afbeelding (2D of 3D).

#### Level/window bij 2D

Het contrast van CT-slices en de panoramische weergaven wordt bepaald door het window en de levelwaarden. Met de instelling voor level/window wordt bepaald welke grijswaarden op het scherm worden weergegeven. Er wordt een selectie weergegeven, gecentreerd rond de levelwaarde en met een breedte van de windowwaarde (evenredig verdeeld aan beide kanten van het level). Het contrast van de CT-slices kan worden aangepast als u deze instellingen wijzigt.

Het level wordt aangepast als u op de muisknop drukt en de muis omhoog en omlaag verplaatst. Het window wordt bijgewerkt als u op de muisknop klikt en de muis naar links (smaller) en rechts (breder) verplaatst.

#### Level/window bij 3D



Bij werken in 3D-weergave wordt het level/windowinstrument gebruikt om de schaling of het centrum van de overdrachtsfunctie te beheren. Zo wordt de hoeveelheid ruis in het patiëntmodel verminderd of worden de kleurinstellingen aangepast. Deze aanpassingen kunnen de visualisatie van het patiëntmodel verbeteren.

Verplaats het centrum van de overdrachtsfunctie zonder de breedte van het bereik te beïnvloeden door op de muisknop te drukken en de muis omhoog en omlaag te verplaatsen. Druk op de muisknop en verplaats de muis naar links of rechts over het patiëntmodel om het bereik van de waarden die worden gebruikt voor het genereren van het patiëntmodel, respectievelijk te vergroten of te verkleinen.

# Patiëntmodel

## EEN 3D-PATIËNTMODEL MAKEN


Voor het maken van een 3D-patiëntmodel is het belangrijk de juiste DICOM-bestanden te selecteren, het meest geschikte interessegebied in te stellen, de optimale isowaarde aan te geven en het juiste kaaktype te selecteren. Het systeem begeleidt u door deze stappen in de wizard Patiënt maken.

1. Open de wizard **Patiënt maken** op een van de volgende manieren:
  - Klik op **Nieuw**  op het tabblad **Medische dossiers** in de DTX Studio™ Implant-taakbalk en klik op **Een nieuwe planning maken**.
  - Klik in de planningsmodule op **Patiënt**  op het tabblad **Patiënt** op de taakbalk **Planning**.
2. Selecteer de juiste set uit de geladen DICOM-datasets of importeer de juiste set.
3. Klik op **Volgende**.
4. Stel het interessegebied (VOI - Volume of Interest) in op de pagina **Interessegebied en isowaarde instellen**.
5. Stel een geschikte isowaarde in met behulp van de **isowaardeschuifbalk** en klik op **Volgende**.
6. Pas de scanrichting aan en stel het vlak van de occlusie in met behulp van de schuifregelaars.
7. Selecteer het kaaktype dat u voor de patiënt wilt behandelen.
8. Klik op **Voltooien**.

## DE VORM VAN DE RESLICECURVE BEWERKEN

Voor de optimale reslicecurve moet de dwarsdoorsnede van de reslice altijd loodrecht op het vlak van de occlusie worden geplaatst. Wanneer er een nieuw patiëntmodel wordt gemaakt, wordt een standaardreslice-curve gemaakt op basis van het geselecteerde kaaktype, interessegebied en het vlak van occlusie. De vorm van deze curve en de grootte van de dwarsdoorsnede van de reslice kunnen worden bewerkt.


Als u de vorm van de reslicecurve wilt bewerken:

1. Klik op **Reslicecurve**  in de groep **CT-editor** op het tabblad **Patiënt**.
2. De actie **Reslicecurve aanpassen** wordt gestart.
3. Stel de berekende curve verder bij door de bestaande besturingspunten te bewerken of een volledig nieuwe curve te genereren door tandbesturingspunten te plaatsen.

### De bestaande Besturingspunten bewerken

1. Klik en sleep de besturingspunten om de vorm van de reslicecurve aan te passen.
2. Voeg een punt in, voeg een eindpunt toe of selecteer en verwijder een punt.
3. Klik op **Voltooien** wanneer u tevreden bent over de vorm van de curve.

### Tandbesturingspunten gebruiken

1. Klik op **Curve opnieuw aanduiden** .
2. Volg de instructies in de knopinfo om de tandbesturingspunten naar wens te plaatsen:
  - Klik op de axiale viewer om de positie van de derde molaar rechts (verstandskies) aan te geven.
  - Klik op de axiale viewer om de positie van de volgende tand aan te geven: de rechter cuspidaat.
  - Klik op de axiale viewer om de positie van de linker cuspidaat aan te geven.
  - Klik op de axiale viewer om de positie van de vierde tand aan te geven: de derde molaar links (verstandskies).


### Opmerkingen:

- De tandnummers die in de knopinfo worden aangegeven, variëren al naar gelang het gebruikte tandnotatiesysteem. Deze notatie kan worden gewijzigd in de **Algemene instellingen**.
- Als de tandmarkeringspunten moeten worden geplaatst op locaties waar de tandcurve niet meer fysiek aanwezig is, plaatst u deze waar deze zich zouden (moeten) bevinden.

3. Deze vier punten - de twee derde molaren en de twee cuspidaten - samen met vijf automatisch gegenereerde besturingspunten vormen de basis voor de reslicecurve.
4. Controleer de curve en stel deze zo nodig verder bij.
5. Klik op **Voltooien** wanneer u tevreden bent over de vorm van de curve.

### De grootte van de dwarsdoorsnede van de reslice aanpassen

Pas de grootte van het perpendiculaire beeld aan om het gewenste beeld in de dwarsdoorsnede van de reslice te zien:

1. Klik op **Reslicecurve**  om de actie **Reslicecurve aanpassen** te openen.
2. Sleep de grenzen van het weergegeven gebied in het perpendiculaire beeld omhoog en/of omlaag of opzij.

**Opmerking:** De boven- en ondergrenzen kunnen onafhankelijk van elkaar versleept worden. Wanneer u de linker- of rechtergrens versleept, zal de tegenoverliggende grens over dezelfde afstand in de tegenoverliggende richting worden verplaatst, om de centrale positie van de dwarsdoorsnede van de reslice te garanderen.

## VISUALISATIE VAN HET PATIËNTMODEL

### Waarschuwing



De gebruiker moet vertrouwd zijn met de interpretatie van CT-gegevens en de manier waarop CT-gegevens worden gevisualiseerd met behulp van volumerendering.

### Wat is een overdrachtsfunctie?

Wanneer een patiëntmodel wordt gemaakt, wordt elke grijswaarde geconverteerd naar een specifieke kleur met een bepaalde opaciteit om het patiëntmodel een specifiek uiterlijk te geven. Om zo ver te komen, wordt een overdrachtsfunctie toegepast, waardoor RGB-waarden en opaciteit aan elke voxel in het volume worden toegewezen. Door toepassing van de overdrachtsfunctie wordt het 3D-volume gevisualiseerd.

Overdrachtsfuncties kunnen worden beheerd en toegepast op het patiëntmodel met behulp van de galerij **Overdrachtsfunctie**. Deze galerij bevat miniatuurweergaven van de verschillende beschikbare overdrachtsfuncties en een aantal acties dat kan worden uitgevoerd met deze overdrachtsfuncties. Voor de huidige patiënt wordt onderscheid gemaakt tussen **ingebouwde overdrachtsfunctiesjablonen, op maat gemaakte sjablonen** en overdrachtsfuncties **'Deze patiënt'**.

## DE VISUALISATIE VAN HET PATIËNTMODEL OPSCHONEN

In de planningsmodus kunnen artefacten en ruis veroorzakende deeltjes in de 3D-weergave worden opgeschoond met de acties **Beeld bijwerken** of **Botartefacten verwijderen**.

### Beeld bijwerken

1. Klik op **Beeld bijwerken** .
2. Klik bij de actie **Beeld bijwerken** op een van de volgende pictogrammen:



Klik op **Snijden** om het gedeelte van het volume aan te geven dat van het model moet worden verwijderd. Alles binnen het gemaakte polygoon wordt verborgen.



Klik op **Isoleren** om het gedeelte van het volume dat u wilt weergeven, aan te geven. Alles buiten het gemaakte polygoon wordt verborgen.



Klik op **Toevoegen** om het gedeelte van het volume dat is weggesneden, weer toe te voegen.

Begin met het maken van het polygoon:


- Klik op de linkermuisknop.
- Verplaats de muis en klik nog eens. De twee geselecteerde posities worden verbonden door een groene stippellijn.
- Klik nog een derde keer. De verbonden groene stippellijn wordt gewijzigd in een polygoon.
- Ga door totdat het gedeelte van het model dat u wilt wegsnijden, in het polygoon is omvat.
- Klik op de rechtermuisknop of druk op **Enter** om toe te passen.

### Botartefacten verwijderen


1. Klik op **Botartefacten verwijderen**  in de groep **Patiënt-editor** op het tabblad **Patiënt**. De actie **Botartefacten verwijderen** wordt gestart.
2. Klik op de knop **Magische gom**  of op **Gom**  in de actie **Botartefacten verwijderen**.
3. Klik op de CT-gegevens of houd de muisknop ingedrukt om de gedeelten te markeren die u uit het patiëntmodel wilt verwijderen. Met de **Magische gom**  wordt het bijgewerkte beeld verwijderd in een klein, middelgroot of groter gebied rond de positie waarop is geklikt, afhankelijk van de kwastgrootte. Met de **Gom**  wordt het bijgewerkte beeld verwijderd in een cirkel rond de positie waar is geklikt. De grootte van de cirkel is afhankelijk van de kwastgrootte die kan worden gewijzigd.

**Opmerking:** De actie **Botartefacten verwijderen** heeft geen invloed op de oorspronkelijke CT-gegevens. Wanneer artefacten zijn verwijderd en het patiëntmodel naderhand wordt bewerkt via de actie **Patiënt bewerken**, zullen de artefacten weer deel uitmaken van het model. Als u beide acties moet uitvoeren om een beter resultaat te bereiken, adviseert Nobel Biocare u het patiëntmodel eerst te bewerken, en mogelijke ruis en artefacten naderhand te verwijderen.

### Bijgewerkt beeld uitschakelen


Gebruik **Beeld bijwerken**  om te wisselen tussen het volledige patiëntmodel en de opgegeven selectie.

### Bijgewerkt beeld resetten

Gebruik **Bijgewerkt beeld resetten**  om het volledige patiëntmodel opnieuw weer te geven zoals dit was gegenereerd.

### Grootste gedeelte behouden

Tijdens het bijstellen van het model met behulp van de actie **Beeld bijwerken** is het mogelijk om, in plaats van het wegsnijden van alle kleinere deeltjes die zorgen voor ruis in de weergave, het gedeelte van het model met het meeste bot te isoleren.

Klik hiervoor op **Grootste gedeelte behouden**  in de acties **Beeld bijwerken** of **Botartefacten verwijderen**. De kleinere deeltjes en gedeelten met een andere dichtheid dan de botdichtheid worden verwijderd. Het gedeelte met het meeste bot blijft zichtbaar.

# Prothetische informatie

## DIAGNOSTISCHE OPSTELLING

Bij gebruik van DTX Studio™ Implant kunnen afhankelijk van de klinische indicaties twee typen scanprotocollen worden gebruikt voor het modelleren van de virtuele diagnostische opstelling:

- Voor kleinschalige gedeeltelijk edentate patiëntcasussen (bij voorkeur nog zes tanden over) kan het protocol zonder scanprothese worden gevolgd (met behulp van een scan van de intraorale situatie).
- Voor edentate patiëntencasussen en voor uitgebreide gedeeltelijk edentate casussen (het advies wanneer minder dan zes tanden over zijn) moet het protocol met scanprothese worden gevolgd.


### Optische scan

#### Een scan van het gietmodel

Het gietmodel wordt gemaakt aan de hand van een afdruk en is de weergave van de intraorale situatie van de patiënt. Met behulp van een prothetische opstelling of waspas kan van het gietmodel een prothetische restauratie worden gemaakt. Het oppervlak van dit model kan door het tandtechnisch laboratorium nauwkeurig worden gescand (gedigitaliseerd). Deze oppervlaktescan kan vervolgens worden geïmporteerd in DTX Studio™ Implant en op basis van DICOM-gegevens worden uitgelijnd op het 3D-model van de patiënt.

Nadat u de afdruk hebt gemaakt, meldt u zich aan bij DTX Studio™ Implant, opent u het patiëntbestand en bestelt u bij het tandtechnisch laboratorium een scan van het gietmodel. Als het tandtechnisch laboratorium het gescande bestand naar de cloudservice heeft geüpload, downloadt u de scan en lijnt u die via SmartFusion™ uit op de DICOM-gegevens van het patiëntmodel.

Een scan van het gietmodel bestellen

1. Open een patiëntbestand, klik op **Producten bestellen** en ga naar de bestelmodule, en klik op **Scannen** .
2. Geef de scanobjecten op de tandenkaart aan door het gebied dat moet worden gescand, te verslepen en de vereiste optie uit het pop-upmenu te selecteren. De vereiste scans worden in de lijst aan de rechterkant getoond.
3. Klik op **Volgende**.
4. Kies het aangesloten tandtechnisch laboratorium dat het gietmodel voor u zal scannen, voer alle benodigde gegevens en speciale instructies in, en controleer de lijst met aangevraagde scans.
5. Klik op **Voltooien**.
6. De bestelling wordt verzonden naar het tandtechnisch laboratorium en toegevoegd aan de lijst **Bestellingen** en weergegeven met het bestelnummer dat van de server is opgehaald.

#### Intraorale scan of een scan met een andere desktopscanner

De intraorale situatie van de patiënt wordt weergegeven aan de hand van een oppervlaktescan die met bijvoorbeeld een intraorale scanner is gemaakt. Deze oppervlaktescan (d.w.z. .ply- en .stl-bestanden) kan vervolgens naar DTX Studio™ Implant worden geïmporteerd en met SmartFusion™ worden uitgelijnd op het 3D-model van de patiënt op basis van de DICOM-gegevens.



## SMARTFUSION™


### De optische scan toevoegen aan het patiëntmodel

De benodigde oppervlaktescan (geüpload door het tandtechnisch laboratorium of geïmporteerd uit de intraorale scanner) kan worden uitgelijnd met het patiëntmodel.

1. Open de behandeling in de planningsmodule.
2. Klik op **Optische scan**  in de groep **Behandelingsscan** op het tabblad **Prothetiek**.
3. Selecteer een optische scan of importeer een bestand met een optische scan.
4. Bij gebruik van .nxa-bestanden wordt de scanner waarmee de optische scan is gemaakt, automatisch ingesteld volgens de gegevens in het geselecteerde bestand. Bij gebruik van .stl-bestanden stelt u de scanner in op:
  - Rechtsonder in de hoek van het venster klikt u op **Scanner selecteren** of **Scanner wijzigen**, als al eerder een scanner is geselecteerd.
  - Kies de scanner uit de lijst.
  - Klik op **Scanner selecteren**.


**Opmerking:** Controleer altijd welke scanner is geselecteerd, vooral als u .nxa-bestanden importeert of wanneer verschillende scanners kunnen worden gebruikt voor optische scans. Wanneer u een specifieke scanner uit de lijst selecteert, wordt die opgeslagen en gebruikt als standaardscanner wanneer u nieuwe patiëntmodellen aanmaakt.

5. Klik op **Volgende**.
6. Als het scanbereik bekend is, wordt automatisch het gebitsbereik aangegeven. U kunt als volgt het bereik voor de geselecteerde optische scan aanpassen:
  - Wijs met de muis de curve in de gebitskaart aan.
  - Klik op de curve - of op het gekleurde gemarkeerde gebied rond de curve - en houd de muisknop ingedrukt.
  - Sleep de aanwijzer over het tanden op de tandenboog tot het gehele scanbereik is geselecteerd. Selecteer een bereik in de optische scan van ten minste drie tanden. Laat de muisknop los.
  - Pas het bereik aan door op de blauwe gemarkeerde gebieden te klikken om een eenheid in- of uit te sluiten. Als u opnieuw wilt beginnen met het aanpassen van het scanbereik, klikt u op **Kaart resetten**. Zorg ervoor dat u een aaneengesloten scanbereik selecteert.

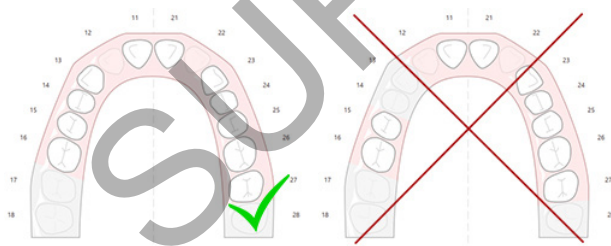

7. Geef de ontbrekende tanden aan door te klikken op een aanwezige witte tand en er een uitgeschakelde tand van te maken. U kunt uitsluitend tanden binnen het gemarkeerde gebitsbereik aangeven als ontbrekende elementen. Neem ten minste één resterende tand op in het scanbereik.
8. Klik op **Volgende**.
9. Geef de positie van alle tanden aan conform de tips in de wizard. Als u een molaar aangeeft, klikt u het midden van de cuspis. Als het een cuspidaat betreft, klikt u in het midden van de snijtandrand. Als u deze stappen nogmaals wilt uitvoeren, klikt u op **Punten opnieuw aangeven**. De puntenset wordt verwijderd, en u kunt opnieuw beginnen.
10. Klik op **Volgende**.
11. Het patiëntmodel en de optische scan worden nu door SmartFusion™ uitgelijnd.

12. Controleer op de pagina **Resultaat controleren** van de wizard **nauwkeurig of de automatische uitlijning correct is**. De omtrek (standaard roze) van de uitgelijnde optische scan moet exact overeenkomen met de occlusale gegevens van de tanden in de (CB)CT-scan. **Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts om erop toe te zien dat deze stap correct is** (zie de beelden op de volgende pagina). Als deze stap niet correct is, initialiseert u SmartFusion™. Neem contact op met de klantondersteuning als u de twee modellen niet nauwkeurig op elkaar kunt uitlijnen.
13. Als de uitlijning correct is, klikt u op **Voltooien**.
14. De optische scan wordt toegevoegd aan de weergave. Als de scan van de virtuele tanden of van de prothetische opstelling/waspas in de bestelling is opgenomen, wordt deze scan ook automatisch toegevoegd.

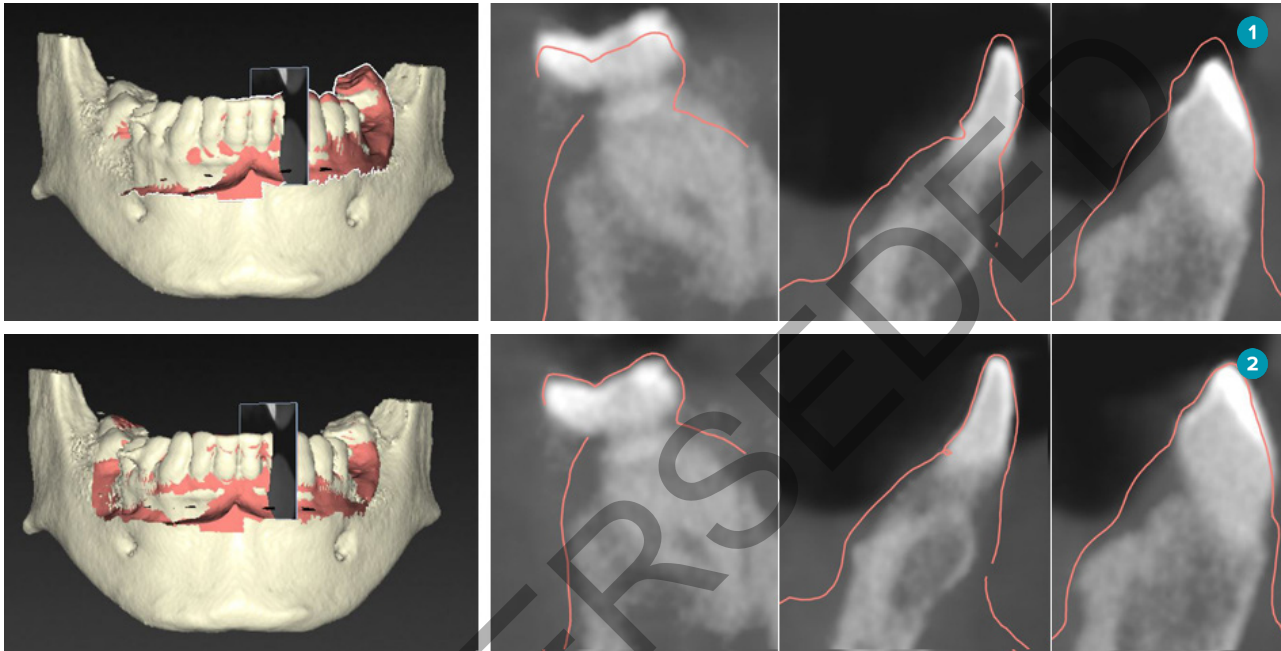

**1** Onjuiste uitlijning

**2** Juiste uitlijning



#### Waarschuwing

Onjuiste uitlijning van de CBCT-scan en de oppervlaktescan zorgt voor een onjuiste chirurgische boormal die waarschijnlijk niet kan worden gebruikt bij de chirurgische ingreep.

#### Initialisatie van SmartFusion™

Wanneer SmartFusion™ van de optische scan en het patiëntmodel mislukt of niet nauwkeurig genoeg is, moet u de beginpositie van de optische scan aanpassen en de SmartFusion™-berekening opnieuw starten. Dit wordt SmartFusion™-initialisatie genoemd.


**Opmerking:** SmartFusion™ is waarschijnlijk minder nauwkeurig als de patiënt minder dan zes tanden heeft.

#### Initialisatieprocedure


Om SmartFusion™ te kunnen initialiseren, moet u minstens drie paar overeenkomende punten definiëren die worden weergegeven op de tanden van respectievelijk het patiëntmodel en de optische scan. Als de punten niet nauwkeurig zijn geplaatst, kunt u ze verwijderen en vervolgens opnieuw aangeven. U kunt alle overeenkomende punten met een enkele muisklik verwijderen.

## De initialisatiewizard starten

- Als u de beginpositie meteen wilt aanpassen wanneer SmartFusion™ wordt uitgevoerd, start u de wizard door op de actie **SmartFusion initialiseren** te klikken.

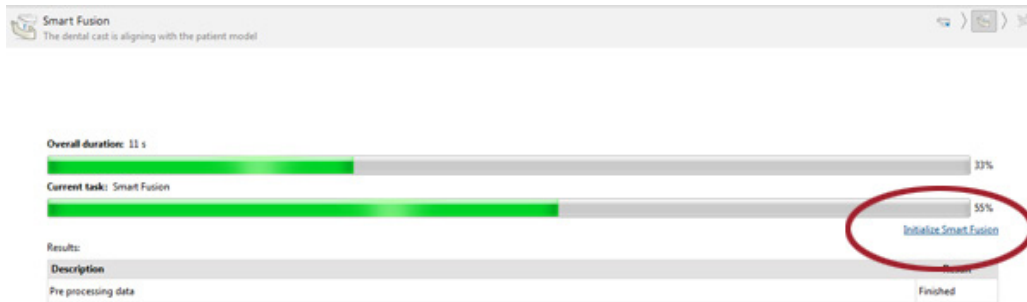

- Wanneer **SmartFusion™** wordt uitgevoerd maar het proces mislukt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven. Klik op **Positie initialiseren** om de initialisatiewizard te openen. Met deze wizard kunt u de startpositie van de optische scan aanpassen. Herstart SmartFusion™.
- Wanneer **SmartFusion™** na een initialisatiepoging wordt uitgevoerd, maar de bewerking weer niet kan worden uitgevoerd, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt u doorgestuurd naar de pagina **Resultaat controleren**. Start op deze pagina de initialisatiewizard door op **Overeenkomende punten aangeven** te klikken (zie onderstaande afbeelding).
- Wanneer **SmartFusion™** wordt uitgevoerd en er doen zich geen problemen voor, maar de optische scan en het patiëntmodel zijn niet goed op elkaar uitgelijnd, start u de initialisatiewizard door te klikken op de actie **Overeenkomende punten aangeven** op de pagina **Resultaat controleren** van de wizard.

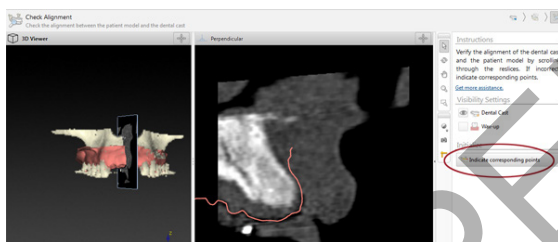


## Overeenkomende punten in de wizard definiëren

Een punt invoegen

- Wanneer de wizard wordt gestart, wordt de actie **Punten invoegen** ingeschakeld.
- Klik op de gewenste positie in het linkervlak van de tanden van het patiëntmodel.
- Klik op de overeenkomende positie in het rechtervlak van de optische scan. Herhaal stap 2 en 3 totdat u minstens drie paar overeenkomende punten hebt gedefinieerd.
- Controleer of er waarschuwingen worden weergegeven in de wizard.
- Wanneer een bericht verschijnt met de mededeling dat het vereiste aantal punten is gedefinieerd, klikt u op **Voltooien** om de wizard te sluiten. Zorg ervoor dat er geen waarschuwingen meer worden weergegeven wanneer u de wizard sluit. Anders kunt u het definiëren van de punten niet voltooien.


**Tip:** Zorg ervoor dat de punten die u toevoegt, gelijkmatig zijn verspreid over de volledige gebitscurve. Plaats de punten niet te dicht bij elkaar. Hoe groter het gebied dat door de punten wordt bestrijkt, hoe correcter de uitlijning zal zijn. Plaats punten in minstens twee van de vier kwadranten, zoals in onderstaande afbeelding.




## Geselecteerde punten verwijderen

**Opmerking:** Als de opties voor het verwijderen van punten zijn uitgeschakeld, klikt u met de rechtermuisknop om de actie **Punten invoegen** te voltooien. De andere acties worden ingeschakeld.

Als u geselecteerde punten wilt verwijderen:

1. Selecteer een punt in een van de viewers.
2. Klik op **Geselecteerde punten verwijderen** .
3. Het geselecteerde punt en het overeenkomende punt worden verwijderd.

## Alle punten verwijderen

Als u alle aangegeven punten wilt verwijderen, klikt u op **Alle punten verwijderen** . Hiermee worden alle gedefinieerde virtuele punten verwijderd.

### Waarschuwingen tijdens het initialiseren van SmartFusion™

De uitlijning van de optische scan is handmatig aangepast.

Als de gebruiker ervoor kiest de handmatige uitlijning te gebruiken voor de SmartFusion™ van de optische scan en het patiëntmodel of wanneer de uitlijning van de optische scan handmatig werd aangepast, wordt hij/zij gewaarschuwd om de uitlijning nog eens extra goed te controleren om mogelijke onnauwkeurigheden te voorkomen.

De uitlijning tussen het patiëntmodel en de optische scan is handmatig aangepast. Controleer nogmaals of de optische scan correct is uitgelijnd met de (CB)CT-scan, aangezien afwijkingen fouten veroorzaken in de juiste plaatsing van de implantaten.

Een of meer aangeduide referentiepunten komen niet overeen.

Het systeem meet de afstand tussen de punten op het patiëntmodel en de overeenkomende punten die op de optische scan zijn aangegeven. Als de afstand groter is dan verwacht, geeft het systeem een waarschuwing af en wordt de gebruiker verzocht de referentiepunten aan te passen.

De punten zijn onvoldoende verdeeld over de optische scan.

Wanneer het systeem detecteert dat de gedefinieerde punten in minder dan twee van de vier kwadranten staan, wordt er een waarschuwing gegeven. De gebruiker wordt gevraagd de overeenkomende punten aan te passen of twee referentiepunten toe te voegen. Tevens wordt erop gewezen dat het belangrijk is dat de punten over de kwadranten van de gebitscurve worden verdeeld. Plaats de punten niet te dicht bij elkaar.



Geef minstens drie overeenkomende punten aan.

Er zijn te weinig referentiepunten gedefinieerd om de wizard te kunnen voltooien. Plaats meer referentiepunten totdat het vereiste minimumaantal geplaatst is.

## AANGEZICHTSSCAN

Laad de aangezichtsscan die moet worden toegewezen aan het patiëntmodel. Het is mogelijk om verschillende scans te laden, één voor één. Het beste resultaat wordt bereikt door eerst een neutrale aangezichtsscan te laden en die vervolgens aan het patiëntmodel toe te wijzen. Naderhand kan er een scan van een lachend gezicht worden geladen die bijvoorbeeld aan de neutrale aangezichtsscan kan worden toegewezen.


### Een optische scan toevoegen aan het patiëntmodel

1. Klik op **Aangezichtsscan**  in de groep **Extra scans** op het tabblad **Prothetiek** om de wizard te starten.
2. Klik op **Een aangezichtsscan selecteren**. Selecteer een aangezichtsscan (.obj-bestand) en klik op **Openen**.
3. Klik op **Volgende**.
4. Controleer de huidige positie van de geüploade scan. U past de uitlijning tussen de geladen aangezichtsscan en het patiëntmodel aan door te klikken op **Uitlijning aanpassen** , het object te selecteren waarop u de aangezichtsscan wilt uitlijnen, en tot slot te klikken op **OK**. Met de wizard kunt u minimaal vijf corresponderende punten aangeven om de scan en het model goed op elkaar uit te lijnen. Klik op **Voltooien** om de wizard voor de overeenkomende punten te sluiten.
5. Klik op **Voltooien** om de wizard **Aangezichtsscan** te sluiten.

Herhaal de bovengenoemde stappen om nog een aangezichtsscan toe te voegen.

### Een aangezichtsscan bijsnijden

Het kan praktisch zijn om de tanden op de scan van een glimlach te verwijderen zodat u het patiëntmodel daadwerkelijk kunt laten zien met bijvoorbeeld de SmartSetup™ door de aangezichtsscan.

1. Klik op **Aangezichtsscan bijsnijden**  op het tabblad **Prothetiek** van de taakbalk of in de wizard **Aangezichtsscan**.
2. Verwijder het gebied dat moet worden weggesneden, door te klikken en te slepen. Gebruik waar nodig de schuifregelaar **Kwastgrootte aanpassen**.
3. Klik op **Voltooien**.

**Opmerking:** Er kan alleen worden bijgesneden op de aangezichtsscan die wordt weergegeven. Als er meerdere scans zijn geladen en u wilt een van de aangezichtsscan bijsnijden, selecteer dan de gewenste aangezichtsscan via het menu **Aangezichtsscan** dat u opent door met de rechtermuisknop te klikken.

## SMARTSETUP™

SmartSetup™ is de oplossing voor het automatisch berekenen van virtuele tanden op basis van een scan van de huidige tandheelkundige situatie. In de berekening wordt rekening gehouden met:

- De grootte, vorm en positie van de bestaande tanden.
- Het type tand dat moet worden ontworpen (een cuspidaat moet anders worden gevormd dan bijvoorbeeld een premolaar).
- De grootte en vorm van de tegenoverliggende tanden.
- Een set esthetische regels voor de tanden vóór in de mond.
- Informatie over de antagonisten, indien beschikbaar.

### Een SmartSetup™ berekenen

Als u een SmartSetup™ wilt berekenen, zorg dan dat een optische scan met ten minste drie resterende tanden beschikbaar is.

1. Klik op **SmartSetup**  in de groep **Extra scans** op het tabblad **Prothetiek**.
2. Klik op **SmartSetup-instellingen** rechtsonder in het deelvenster met de tandenboog en pas de SmartSetup™-instellingen aan voor verschillende SmartSetup™-uitkomsten.
3. Klik op **Berekenen**. De SmartSetup™ wordt berekend.


## SmartSetup™ -instellingen

De instellingen van de SmartSetup™-wizard kunnen worden aangepast om het resultaat van de SmartSetup™-berekening te wijzigen.

- Klik op de pagina **De SmartSetup™ controleren** van de wizard **SmartSetup™** op de **SmartSetup™-opties** rechtsonder in het deelvenster met de tandenboog om het dialoogvenster **Instellingen** te openen.
- Geef in de groep **Kwaliteit** aan op welk kwaliteitsniveau u de modellen wilt berekenen: **Maximum** (deze berekening kost wat tijd), **Optimaal** of **Laag**. Afhankelijk van uw keuze worden meer of minder tanden opgenomen in de berekening.
  - **Maximaal**: alle gescande tanden worden opgenomen in de berekening van de SmartSetup™. De berekening duurt langer dan bij de optie **Optimaal**.
  - **Optimaal**: de tanden die nodig zijn om een optimaal resultaat te verkrijgen, worden opgenomen in de berekening, waarbij de berekeningstijd binnen het redelijke wordt gehouden.
  - **Laag**: er wordt voor de berekening van de SmartSetup™ een minimum aantal tanden gebruikt. De berekeningstijd is korter dan bij de optie **Optimaal**.
- In de **SmartSetup™**-groep kunt u aan de hand van de volgende criteria aangeven of u de virtuele tanden wilt berekenen:
  - **Spleten tussen tanden verwijderen voor gebitsopstellingen**: in de meeste gevallen zult u de spleten tussen aangrenzende tanden willen verkleinen. Er zijn evenwel situaties waarin de spleet die moet worden gevuld veel te groot is. Als u deze optie inschakelt, wordt de virtuele tand mogelijk te groot. In een dergelijk geval kunt u de optie **Spleten tussen tanden verwijderen voor gebitsopstellingen** beter uitschakelen. Deze optie is standaard geselecteerd voor **Alle tanden**. In het vervolgkeuzemenu kunt de tand(en) selecteren waarvoor u de tussenliggende openingen wilt verwijderen.
  - **Positie baseren op tegenover elkaar staande tanden (spiegelbeeld)**: selecteer deze optie als u de SmartSetup™ precies zoals de tegenoverliggende tanden wilt plaatsen. Houd er echter rekening mee dat patiënten doorgaans geen volledig symmetrische tandcurve hebben en dat het gebruik van deze optie kan leiden tot minder dan optimale resultaten. Deze optie is daarom standaard uitgeschakeld. U kunt de optie echter naar believen in- en uitschakelen, om te zien welk resultaat het oplevert.
  - **Esthetiek voortanden optimaliseren**: Deze actie is gebaseerd op een set met regels voor het bepalen of berekenen van het beste esthetische resultaat. Denk hierbij aan dit soort regels: de incisale rand van de centrale incisieven moet dezelfde hoogte hebben en dezelfde breedte moet worden toegepast op de centrale incisieven. Dit geldt ook voor de laterale incisieven en de cuspidaten.
  - **Derde molaar/molaren opnemen**: Deze optie wordt standaard geselecteerd als de drie molaren in het scanbereik zijn opgenomen. Bij het berekenen van de grootte, vorm en positie van de SmartSetup™, wordt rekening gehouden met de grootte, vorm en positie van de derde molaar/molaren.
  - **Occlusie extra scherpstellen**: wanneer informatie over antagonisten beschikbaar is, wordt deze optie standaard geselecteerd. Met de informatie over antagonisten wordt rekening gehouden bij het verder afstellen van de occlusie.
- Klik op **OK** om de instellingen van de berekening van de SmartSetup™ toe te passen. Ga verder met de wizard door op **Volgende** te klikken.

## Een SmartSetup™ bewerken

U bewerkt als volgt de positie van elke berekende SmartSetup™ afzonderlijk:

- Klik op **SmartSetup bewerken**  op het tabblad **Prothetiek** van de taakbalk **Planning**. Of klik op **SmartSetup bewerken** op de pagina **Resultaat controleren** van de wizard **SmartSetup**.
- Selecteer de SmartSetup™ die u wilt bewerken, door erop te klikken in de 3D Viewer of door de tand in de keuzelijst te selecteren.
- Klik op de acties **Translatie**, **Rotatie** en/of **Schaal** om de positie en de grootte van de geselecteerde SmartSetup™ aan te passen.



	Translatie	<p>Klik op de SmartSetup™, houd de muisknop ingedrukt en versleep om de SmartSetup™ te verplaatsen.</p> <p>Pas de waarden in de vakken <b>Buccaal/linguaal</b>, <b>Mesiaal/distaal</b> en/of <b>Occlusaal</b> aan om de positie van de SmartSetup™ verder af te stellen.</p>
	Rotatie	<p>Klik op de SmartSetup™, houd de muisknop ingedrukt en versleep om de SmartSetup™ te draaien.</p> <p>Pas de waarden in de vakken <b>Buccaal/linguaal</b>, <b>Mesiaal/distaal</b> en/of <b>Occlusaal</b> aan om de positie van de SmartSetup™ verder af te stellen.</p>
	Schaling	<p>Klik op de SmartSetup™, houd de muisknop ingedrukt en versleep om de schaal van de SmartSetup™ aan te passen. Versleep omhoog om de schaal te verhogen; versleep omlaag om die te verlagen.</p> <p>Of gebruik het vak <b>Schalen</b> om een specifiek schalingspercentage in te stellen of om de grootte van de SmartSetup™ verder af te stellen.</p>

Om de wijzigingen voor de geselecteerde SmartSetup™ ongedaan te maken, klikt u op  **Tand resetten**.

## MODEL VOOR SCANPROTHESE


Op basis van de klinische diagnostiek van de patiënt wordt een scanprothese gemaakt van een klinisch gevalideerde tandopstelling met markeringen voor de dubbele-scanprocedure. Het virtuele model wordt geconstrueerd wanneer het patiëntmodel wordt gemaakt.

Als u de scanprothese wilt maken:

1. Open de wizard Scanprothese maken door op **Scanprothese**  te klikken.
2. Selecteer de juiste DICOM-gegevens en klik op **Volgende**.
3. Stel het interessegebied (VOI) in.
4. Bij gebruik van de toepasselijke kalibratieset wordt de **Gekalibreerde isowaarde** geladen. Klik op **Volgende**.
5. Controleer de scanprothese.
6. Patiëntmodel en scanprothese worden automatisch uitgelijnd.
7. Controleer het uitlijningsresultaat en klik op **Voltooien**.

## GINGIVA-OPPERVLAK

Een gingiva-oppervlak maken op basis van de scanprothese, gaat als volgt:

1. Klik op **Gingiva**  op het tabblad **Prothetiek** van de taakbalk **Planning**.
2. Controleer het gingiva-oppervlak en klik op **Voltooien**.


# Diagnosticeren

## ZENUWEN

Voor het afbakenen van een zenuw klikt u op **Zenuw**  op het tabblad **Diagnose**. Er wordt een wizard geopend.


1. Pas indien nodig de zenuw-reslice aan.
2. Klik om de constructiepunten van de zenuw aan te geven.
3. Klik op de rechtermuisknop om het toevoegen van punten te beëindigen.
4. Klik op **Voltooien**.

De bolletjes zijn met elkaar verbonden via een buisachtige lijn die de zenuw voorstelt.

U kunt nog een zenuw toevoegen door de optie **Nieuwe zenuw toevoegen**  in de groep **Zenuwacties** te kiezen. Begin met het aangeven van de punten van de nieuwe zenuw op basis van het hierboven beschreven proces.




**Tip:** Pas de zenuw-reslice aan als het moeilijk is om het zenuwkanaal te visualiseren. Deze U-vorm is niet gekoppeld of gerelateerd aan de vorm van de reslicecurve.

## TANDEN

Als u een tand wilt annoteren, klikt u op **Tand**  op het tabblad **Diagnose**. Er wordt een wizard geopend.

1. Selecteer op de kaart bovenaan de tand die u wilt annoteren.


**Opmerking:** Als standaard wordt hier de FDI-notatie gebruikt. Wijzig zo nodig de tandkaartnotatie via de **Algemene instellingen**.

2. Stel de positie van de geselecteerde tand af om de centrale as ervan aan te passen.
3. Klik op **Vullen met magische markering**  of op **Markeringspenseel** .
4. Schuif door de CT-slices en klik of sleep om de tand beetje voor beetje te markeren. Alle gegevens in een specifiek gebied rond de positie waar geklikt is, wordt gekleurd en aan de tand toegevoegd.
5. Klik op **3D bijwerken**  of gebruik de sneltoets [u]. De tand wordt weergegeven in een 3D-voorbeeld en toegevoegd aan het patiëntmodel in de 3D-viewer.
6. Selecteer op de kaart zo nodig een nieuwe tand die u wilt annoteren.
7. Wanneer alle tanden geannoteerd zijn, klikt u op **Voltooien**.

## TANDEN UIT HET MODEL VERWIJDEREN

Wanneer tanden zijn geannoteerd, is het mogelijk deze terug te trekken uit het patiëntmodel, afzonderlijk of tegelijkertijd.


### Alle tanden tegelijkertijd verwijderen

1. Klik op **Tanden verwijderen**  op het tabblad **Patiënt**. Dit pictogram wordt alleen ingeschakeld als er tanden geannoteerd zijn.
2. Corrigeer het patiëntmodel zo nodig via de acties **Beeld bijwerken** of **Botartefacten verwijderen**.

**Opmerking:** Wanneer nieuwe tandannotaties worden toegevoegd of wanneer tanden worden bewerkt nadat er een verwijdering heeft plaatsgevonden, voert u de actie **Verwijderen** opnieuw uit als u deze ook op de zojuist toegevoegde of bewerkte tanden wilt toepassen. De actie wordt niet automatisch uitgevoerd. Of gebruik de actie **Tand trekken**.



### Eén tand/kies trekken

1. Klik op het geannoteerde element om dit te selecteren.
2. Klik op **Tand trekken**  in de groep **Diagnose** op de taakbalk **Diagnose**. Dit pictogram **Tand trekken** wordt alleen ingeschakeld nadat tanden zijn geannoteerd.
3. De getrokken tand is rood gekleurd.

### METINGEN

Diverse meettypen zijn beschikbaar.

**Tip:** Als de tekst van de metingen moeilijk leesbaar is omdat deze wordt verborgen door de objecten in de viewer, kunt u de annotatie of tekst selecteren om het resultaat van de meting weer te geven in de statusbalk.

Afstand tussen 2 punten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik op <b>Afstand</b>  op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li> <li>2. Klik om het eerste punt aan te geven en klik dan nogmaals op een tweede positie. De meting wordt weergegeven.</li> </ol>
Hoek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik op <b>Hoek</b>  op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li> <li>2. Geef de drie punten a, b en c aan.</li> <li>3. De hoek wordt gevisualiseerd door middel van een boogje en de meetwaarde wordt weergegeven.</li> </ol>
Grijswaarde/Hounsfield-eenheden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik op <b>HU-waarde</b>  op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li> <li>2. Geef een punt aan waarop u de grijswaarde wilt meten.</li> </ol>
Hoek tussen implantaten of abutments	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer een implantaat en klik op <b>Hoek tussen implantaten</b>  op het tabblad <b>Diagnose</b>.</li> <li>2. Selecteer het tweede implantaat. Een gebogen gele lijn duidt op de meting samen met de waarde.</li> </ol>

# Implantaten plannen

## WERKEN MET IMPLANTATEN VAN ANDERE FABRIKANTEN DAN NOBEL BIO CARE

DTX Studio™ Implant is ook geschikt voor implantaatsystemen van andere fabrikanten dan Nobel Biocare (bijvoorbeeld, tandheelkundige Straumann-implantaten, tandheelkundige Dentsply-implantaten, tandheelkundige Camlog-implantaten, enzovoort). Op het tabblad **Implantaatproducten** in het dialoogvenster **Voorkeuren** kan de gebruiker aangeven welke implantaatsystemen moeten worden toegevoegd aan DTX Studio™ Implant.

**Opmerking:** Er is een internetverbinding vereist om implantaten van andere fabrikanten dan Nobel Biocare te downloaden naar DTX Studio™ Implant.

U kunt alleen implantaatsystemen aan DTX Studio™ Implant toevoegen of eruit verwijderen wanneer alle planningsscenario's zijn gesloten. Sluit daarom alle patiëntbestanden en ga naar het dialoogvenster **Voorkeuren**:

1. Klik op het tabblad **DTX Studio Implant**.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Klik op **Geïnstalleerde producten**.
4. Geef aan welke implantaatsystemen moeten worden toegevoegd aan of worden verwijderd uit de software.
5. Klik op **OK** om af te ronden.

**Opmerking:** Wanneer producten worden gebruikt die niet beschikbaar zijn in de software, zullen deze in het behandelplan vervangen worden door cilindervormige dummyproducten. De oorspronkelijke productinformatie wordt echter opgeslagen en zodra de producten beschikbaar zijn, worden de dummy's in het behandelplan vervangen door een meer gedetailleerde weergave van de producten.



**Waarschuwing:** Wanneer waarschuwingen worden geactiveerd vanwege de cilindervormen, worden deze waarschuwingen berekend op basis een schatting van de productvorm.

## EEN IMPLANTAAT TOEVOEGEN AAN EEN BEHANDELPLAN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een implantaat virtueel kunt plannen. Het is echter raadzaam dat u bekend bent met en zich bewust bent van de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen die gepaard gaan met het plannen van orale implantaten.

Doorloop de volgende stappen om een implantaat toe te voegen aan het behandelplan:

1. Klik op **Implantaat**  op het tabblad **Plannen**.
2. Klik op het patiëntmodel om het schouderpunt van het implantaat aan te geven.
3. Klik op het model om de apex van het implantaat aan te geven.
4. Selecteer de juiste fabrikant uit het gedeelte **Fabrikant** in het venster **Productselectie**.
5. Selecteer een implantaat. Geef eventueel ook het chirurgietype en een compatibel abutment aan, en controleer de tandpositie.
6. Klik op **Product selecteren** om te bevestigen.



**Waarschuwing:** Producten die niet beschikbaar zijn, worden weergegeven met een rode waarschuwing in het venster **Productselectie** en worden blauw weergegeven in de 3D-weergave. Deze producten kunnen niet worden besteld.

### Wat betekent de gele zone?

De standaardtolerantie van het NobelGuide-concept ligt binnen 1,5mm. De semitransparante gele zone helpt de gebruiker zich bewust te zijn van dit aspect met betrekking tot vitale structuren. De zone is een cilinder die 1,5mm groter is dan de radius van de werkelijke implantaten, gecombineerd met een kegelvorm van 3mm hoog.

Het waarschuwt de gebruiker voor de potentiële risico's wanneer de gele zone zichtbaar wordt door het buitenoppervlak van het bot.

### Opmerkingen:

- Boren mogen 1mm langer uitsteken dan het geplande implantaat/de geplande implantaten. Deze gele waarschuwingszone houdt ook rekening met deze variatie.
- Het verdient aanbeveling om tussen twee implantaat-botinterfaces ten minste 3mm gezond bot te houden en om een minimale afstand van 1,5mm aan te houden tussen een tand en een implantaat zodat herkolonisatie van cellen met een goede bloedtoevoer kan plaatsvinden.
- Het NobelGuide-concept omvat verschillende klinische stappen die de behandelaar voor elke afzonderlijke casus in overweging moet nemen. Voor de algehele nauwkeurigheid van elke afzonderlijke casus moet daarom rekening worden gehouden met de invloed van deze procedures.

### Tandpositie

Aan implantaten wordt een specifiek tandnummer toegewezen. Dit tandnummer verschijnt op verschillende plaatsen in de software, zoals in het **eigenschappenvenster** van een implantaat, op het speciale tabblad van een implantaat, in het menu dat wordt geopend door op de rechtermuisknop te klikken, en op de statusbalk wanneer het implantaat wordt geselecteerd.

### Tandenkaart

Met de tandenkaart kan de gebruiker de geschatte tandpositie waaraan een implantaat is toegewezen, controleren en zo nodig aanpassen. De conventie voor tandnummering op deze tandenkaart komt overeen met de instelling in de algemene instellingen.



De ?-positie (vraagtekenpositie) wordt gebruikt voor tandposities die onbekend of onduidelijk zijn (bijvoorbeeld wanneer een implantaat wordt gepland tussen twee posities waarvoor al andere implantaten zijn gepland).

## EEN IMPLANTAAT MANIPULEREN

DTX Studio™ Implant biedt verschillende functies voor het plannen van de optimale positie van het implantaat.

### De oriëntatie van een implantaat wijzigen

De oriëntatie van een implantaat kan worden gewijzigd door de bolletjes te verslepen.

1. Selecteer het implantaat. De bolletjes worden rood.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
  - Klik op het bovenste bolletje op het implantaat en versleep dit om het te draaien, waarbij de apicale punt als draaipunt wordt gebruikt.
  - Klik op het onderste bolletje op het implantaat en versleep het om het te draaien waarbij het schouderpunt van het implantaat als draaipunt wordt gebruikt.

### Een implantaat verplaatsen

Als u het implantaat fysiek wilt verplaatsen:

1. Selecteer een implantaat. De grijze buis van het implantaat wordt groen.


2. Klik op de groene buis en sleep het implantaat naar de gewenste oriëntatie. Het implantaat behoudt zijn oorspronkelijke stand.

Diepte en rotatie kunnen ook worden gewijzigd via pictogrammen op de specifieke taakbalk **Implantaat**.

### Implantaten parallel zetten


#### Een parallel implantaat plaatsen

Als u één nieuw implantaat parallel aan een geselecteerd implantaat wilt plaatsen:

1. Selecteer het implantaat dat u als basis wilt gebruiken.
2. Klik op **Parallel implantaat** .
3. Klik in de 3D- of 2D-viewer om het schouderpunt van het implantaat aan te geven.
4. Het nieuwe implantaat wordt parallel aan het aangegeven implantaat geplaatst.

#### Alle implantaten parallel plaatsen

Als u alle beschikbare implantaten in het plan parallel wilt plaatsen:


1. Selecteer het implantaat dat u als basis wilt gebruiken.
2. Klik op **Alles parallel plaatsen** .
3. Alle implantaten worden parallel geplaatst aan het aanvankelijk geselecteerde implantaat.

**Opmerking:** Na de opdracht **Alles parallel plaatsen** dienen alle implantaatposities zorgvuldig te worden geïnspecteerd. Indien het resultaat klinisch onaanvaardbaar is, gebruikt u de functie **Ongedaan maken**.

## ABUTMENTS

Als u een geschikt abutment voor een implantaat wilt selecteren:

1. Selecteer het implantaat in de weergave.
2. Klik op **Abutment**  op het tabblad **Implantaat** of klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde implantaat en kies de optie **Abutment toevoegen** in het snelmenu.
3. Het venster **Productselectie** wordt geopend en geeft de compatibele abutments weer.
4. Standaard is **Geen abutment** geselecteerd. Selecteer een abutment, rekening houdend met de juiste afmetingen.
5. Klik op **Product selecteren**.

**Opmerking:** Deze opties zijn alleen beschikbaar als het geselecteerde implantaat nog niet van een abutment is voorzien. Als er al een abutment aanwezig is, klikt u op het menu-item **Product wijzigen** of op het pictogram  om het venster **Productselectie** weer te geven.

### Het chirurgietype instellen

De behandelaar heeft verschillende chirurgische opties, die chirurgietypes worden genoemd, voor de behandeling van de patiënt (freehand, met een chirurgische boormal enkel bij het pilotboren of met een chirurgische boormal voor fully-guided surgery). Het chirurgietype kan voor elk implantaat in het behandelplan afzonderlijk worden ingesteld.

1. Selecteer het implantaat.
2. Klik op het pictogram **Chirurgietype** op het desbetreffende tabblad op de taakbalk. De vorm van het pictogram is afhankelijk van het chirurgietype.
3. Selecteer het juiste chirurgietype in de lijst. De beschikbaarheid van de opties is afhankelijk van het geselecteerde implantaattyp.

#### Opmerkingen:

- Wanneer een nieuw implantaat wordt geplaatst, kan het chirurgietype worden ingesteld op het tabblad **Chirurgietype** van het venster **Productselectie**.



- Het chirurgietype kan worden aangepast in het venster **Chirurgieopstelling controleren** wanneer een chirurgische boormal wordt gemaakt.

### Verschillende chirurgietypen

Afhankelijk van de producten die in het behandelplan zijn geselecteerd, zijn verschillende chirurgische opties mogelijk. De volgende chirurgietypen zijn beschikbaar:

- ☐ **Freehand:** bij het plaatsen van dit implantaat wordt geen chirurgische boormal (geen guided sleeve) gebruikt.
- ☒ **Fully-guided:** er wordt een chirurgische boormal met een fully-guided sleeve gebruikt (waardoor geleid boren en geleide plaatsing van het implantaat mogelijk is) om de geplande positie(s) van het implantaat in de mond van de patiënt over te brengen.
- ☐ **Pilotboren (alleen voor NobelGuide twist drills van 1,5 en 2,0mm):** er wordt een chirurgische boormal met een pilot sleeve (enkel voor geleid pilotboren) gebruikt om de geplande positie(s) van het implantaat in de mond van de patiënt over te brengen. Nadat deze pilotboor is gebruikt, wordt de chirurgische boormal verwijderd, wordt de diepte van het guided boorgat opgenomen door de richtingindicator of freehand twist drill ten opzichte van een anatomisch referentiepunt (bijvoorbeeld de bovenkant van een bot) en wordt de freehand-boorprocedure gestart, gevolgd door de freehand-plaatsing van het implantaat (alle diepten van freehand-instrumenten conform het gedefinieerde, anatomische referentiepunt na verwijdering van de template). Afhankelijk van de implantaatdiameter kan er een andere diameter voor de pilot sleeve worden geselecteerd.

### Verschuiving pilot sleeve

Deze functie is alleen bedoeld voor pilotboren. Bij bepaalde klinische indicaties is de standaardafstand tussen het geplande implantaat (implantaatschouder) en de sleeve niet groot genoeg (bijvoorbeeld dat het implantaat dieper moet worden geplaatst, scherpe kaakbeenrand die moet worden verwijderd na plaatsing van het implantaat, irritatie van sleeve met aangrenzende tanden, enzovoort). Bij deze indicaties komt de sleeve op de standaardpositie in botsing met het oppervlaktemodel van de optische scan en wordt er een waarschuwing gegeven voor pilotsleeves. Om een chirurgische boormal zonder sleeve-contact te maken en het implantaat op de geplande klinische positie te houden, kan de sleeve omhoog worden verplaatst. De standaardverhouding van guided sleeves en het geplande implantaat is terug te zien in de dieptemarkeringen van alle guided NobelGuide-boren voor alle boorprotocollen. De extra afstand wordt 'verschuiving' van de sleeve genoemd en wordt automatisch vastgelegd. Deze afstand wordt toegevoegd aan de NobelGuide-pagina met chirurgische instructies die wordt geleverd bij de chirurgische boormal.

1. Selecteer een implantaat.
2. Zorg ervoor dat het chirurgietype voor het geselecteerde implantaat **Pilot** is.
3. Klik op het pictogram **Sleeve-verschuiving** naast het pictogram **Chirurgietype** op het desbetreffende tabblad **Implantaat**. Of klik met de rechtermuisknop op het implantaat en selecteer **Sleeve-verschuiving** in het pop-upmenu.
4. Versleep de schuifregelaar om de positie van de sleeve in hoogte aan te passen of voer de verschuivingshoogte in het schuifregelaarvak in.

### Rotatie pilot sleeve

Als de sleeves zich niet in de juiste rotatiepositie bevinden, kan de rotatie met behulp van de sleeve-rotatie worden aangepast.

1. Klik met de rechtermuisknop op een implantaat.
2. Klik in het pop-upmenu op **Rotatie sleeve**.
3. Versleep de schuifregelaar om de sleeve te draaien totdat de juiste rotatiepositie is bereikt.

### BOTKAMREDUCTIE

Gebruik de actie **Botkamreductie** als u een vlak wilt aangeven dat het ideale botniveau voor de patiënt is. Hierbij wordt niets verwijderd. Het is een visualisatie van waar het bot kan worden weggesneden om het plannen van de behandeling voor u gemakkelijk te maken.

1. Klik op **Botkamreductie**  in de groep **Plannen** op het tabblad **Plannen** van de taakbalk.
2. Er wordt een paars vlak aan het patiëntmodel toegevoegd.
3. Klik op het vlak om dat te selecteren. Sleep de gekleurde handgrepen naar de randen om de grootte en positie van het vlak aan te passen. Gebruik de schuifregelaar **Vlakhoogte** in het menu dat u opent door met de rechtermuisknop te klikken, om de positie van het vlak ten opzichte van de Z-as van het model aan te passen.

## ANKERPINNEN

Voor een goede fixatie aan het begin van de ingreep wordt de chirurgische boormal verankerd met guided ankerpinnen. Bij het plannen van guided ankerpinnen zijn de hoek en diepte van groot belang. Gewoonlijk worden in een edentate kaak drie of vier ankerpinnen geplaatst. De ankerpinnen moeten worden geplaatst in gebieden met voldoende corticaal bot. Om het risico van weefselschade tot een minimum te beperken, moet bi-corticale verankering van ankerpinnen worden vermeden.

### Opmerkingen:

- De positie en oriëntatie van de ankerpin moeten zowel een eenvoudige installatie mogelijk maken (overweeg retractie van de lip en de mondopening) als kritieke structuren zoals bloedvaten vermijden.
- Als u de positie van de chirurgische boormal nauwkeurig in de mond van de patiënt wilt plaatsen, adviseren wij u een chirurgische index te gebruiken. De chirurgische index moet ruimte bieden voor het boren en plaatsen van de ankerpinnen. Na plaatsing van de ankerpinnen kan de chirurgische index worden verwijderd.

### Een ankerpin toevoegen aan het behandelplan

Plaats een ankerpin op vergelijkbare wijze als een implantaat.

1. Klik op **Ankerpin** .
2. Klik om de ankerpin aan te geven.
3. Klik om de apex van de ankerpin aan te geven.
4. De ankerpin wordt in de weergave geplaatst.

**Tip:** Het is handiger de schouder- en apexpunten aan te geven op een geschikte 2D-reslice.

### Juiste inclinatie en diepte van ankerpinnen

Op strategische posities kunnen ankerpinnen worden geplaatst waarmee de chirurgische boormal voor het plaatsen van het implantaat kan worden gestabiliseerd. De hoek en diepte van die ankerpinnen zijn van cruciaal belang.


De ankerpinnen kunnen tijdens de ingreep ook worden gebruikt als retractie voor de lippen. Ankerpinnen die te ver uit elkaar in de curve staan, kunnen een negatief effect hebben op de mondopening. Er is een versie met korte as van de ankerpin verkrijgbaar waarmee dit mogelijk negatieve effect kan worden tegengegaan. De plaatsing van ankerpinnen moet echter zo worden gepland dat een goede toegang is gewaarborgd en de locatie van het implantaat vrij blijft.

De sleeves moeten dicht bij de mucosa worden geplaatst, die wordt aangegeven door het gedigitaliseerde oppervlakmodel van de intraorale situatie (op ongeveer 0,5 tot 1 mm afstand van de mucosa) maar mogen dit model niet hinderen of raken wanneer er een SmartFusion-oppervlaktescan wordt gebruikt.


Bij edentate patiënten moeten minimaal vier ankerpinnen worden geplaatst. De sleeves van de ankerpinnen worden vanuit extraoraal geplaatst in het vestibulum, of in bepaalde situaties vanuit tegenovergestelde richting (palataal of linguaal) om de chirurgische boormal aan twee kanten vast te zetten.

### Ankerpinnen en scanprothese (behandelstappen in edentate situaties)

Wanneer u een scanprothese gebruikt, moet de sleeve contact maken met de boormal, maar mag deze niet uitsteken in het gingiva-oppervlak.




**Juist**



**Onjuist**

De sleeve van de ankerpin is niet bevestigd aan de scanprothese en wordt niet bevestigd aan de chirurgische boormal.



**Onjuist**





De sleeve van de ankerpin steekt uit de scanprothese en de chirurgische boormal past niet in de mond van de patiënt.

SUPERSEDED





**Ankerpinnen en optische scan (behandelstappen in gedeeltelijk edentate situaties)**



Wanneer u een SmartFusion-oppervlaktescan gebruikt, moet de sleeve dicht bij de mucosa worden geplaatst (ongeveer 0,5 mm tot 1 mm van de mucosa, volgens de oppervlaktescan), maar mag deze niet in de SmartFusion-oppervlaktescan uitsteken.

**Juist****Onjuist**

De sleeve van de ankerpin steekt uit de optische scan (zacht weefsel) en de chirurgische boormal past niet in de mond van de patiënt.

**Onjuist**

De ankerpin is niet verankerd in het bot en is niet bevestigd aan de optische scan. Er wordt rond de sleeve geen boormateriaal toegevoegd.

**Onjuist**

De ankerpin is niet verankerd in het bot, er wordt boormateriaal toegevoegd rondom de sleeve, maar deze ankerpin biedt geen fixatie tijdens de ingreep.

# Een behandelplan inspecteren

Wanneer u het pad van een implantaat of ankerpin door het bot moet inspecteren, is het mogelijk om slices te bekijken door het beeldvolume langs een implantaat of ankerpin, en parallel aan dat implantaat of die ankerpin. Met deze functie kunt u het botweefsel rond implantaten en ankerpinnen in detail controleren en er zo voor zorgen dat de gekozen positie geschikt is voor het plaatsen van implantaten of ankerpinnen.

## WERKEN MET DE KLIKFUNCTIONALITEIT

De klikfunctionaliteit van de dwarsdoorsnede van de reslice werkt in verschillende modi:

- In de **implantaat- of ankerpinmodus** wordt de dwarsdoorsnede van de reslice geklikt aan de hoofdas van een implantaat of ankerpin en in het midden van het implantaat of de ankerpin geplaatst.
- In de **boogmodus** wordt de dwarsdoorsnede van de reslice geklikt aan de boog van de panorama-reslice.

Als u de dwarsdoorsnede van de reslice aan een implantaat of ankerpin wilt vastklikken:

1. Klik op **Reslice vastklikken**  in het deelvenster **Tools**.
2. De dwarsdoorsnede van de reslice wordt aan het geselecteerde implantaat of de geselecteerde ankerpin vastgeklikt en draait rond de as ervan. Deze reslice volgt dus niet de boog van het kaakbeen. Als er geen implantaat of ankerpin is geselecteerd, wordt de reslice aan het laatst geselecteerde implantaat of de laatst geselecteerde ankerpin geklikt. Wanneer er nog geen implantaat of ankerpin is geselecteerd, wordt de reslice aan het laatst geplande implantaat of de laatst geplande ankerpin geklikt.

**Tip:** Wanneer u een ander implantaat of een andere ankerpin selecteert, wordt de reslice automatisch aan het nieuwe implantaat of ankerpin geklikt. Deze functionaliteit kunt u uitschakelen onder de algemene instellingen.

**Opmerking:** Wanneer u het laatste implantaat in de weergave verwijdert, klikt de dwarsdoorsnede van de reslice automatisch vast aan de boog als die aan het implantaat is geklikt.

## NAAR EEN ANDER IMPLANTAAT OF EEN ANDERE ANKERPIN SPRINGEN


Wanneer de klikfunctionaliteit in de implantaat- of ankerpinmodus staat, kunt u naar een ander implantaat of een andere ankerpin gaan met behulp van de actie **Volgende**, die wordt weergegeven in de **Vastklikken**-balk in de 2D-viewer.

1. Klik op de Vastklikken-balk op **Volgende**.
2. De dwarsdoorsnede van de reslice verplaatst zich naar het volgende implantaat of de volgende ankerpin in de reeks.

## TERUGGAAN NAAR DE BOOGMODUS

Wanneer de klikfunctionaliteit in de implantaat- of ankerpinmodus staat, kunt u terugkeren naar de boogmodus met de actie **Losklikken** op de **Vastklikken**-balk.

1. Klik op de Vastklikken-balk op **Losklikken**.
2. De dwarsdoorsnede van de reslice wordt vastgemaakt aan de boog.

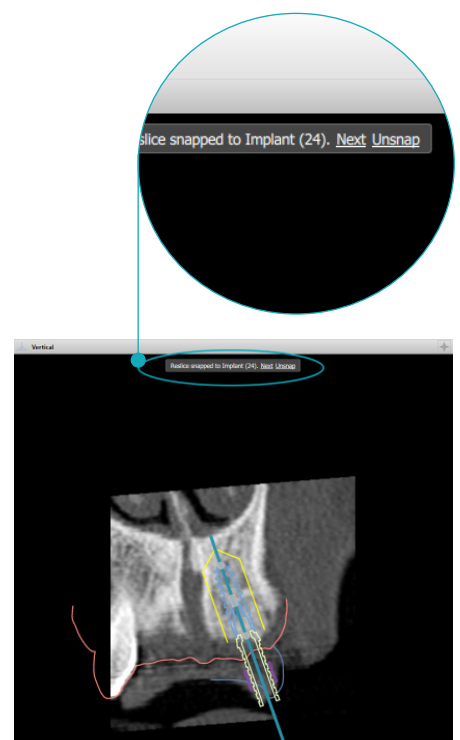

# Voltooien

## EEN CHIRURGISCHE BOORMAL MAKEN

De chirurgische boormal helpt u om de ingreep precies volgens planning uit te voeren. Bij het afronden van het plan maakt u een virtuele chirurgische boormal. Dit is een voorbeeld van wat u ontvangt.


Als u een chirurgische boormal volgens het behandelplan wilt maken:

1. Klik op **Boormal maken**  op het tabblad **Voltooien**. Er wordt een venster geopend waarin u de implantaatposities met de geselecteerde sleeves (chirurgietypen) kunt controleren. Standaard wordt de chirurgische boormal door Nobel Biocare geproduceerd. Als u wilt dat de boormal ter plaatse wordt gemaakt of door een andere fabrikant, selecteert u **Overige**. Selecteer de fabrikant uit de lijst. Als u uw accountnaam selecteert, kunt u de boormal zelf van DTX Studio™ Go downloaden. Als u een van uw connecties selecteert, is de boormal te downloaden. Voeg de nodige details toe en wijzig, indien nodig, het geselecteerde chirurgietype.
2. Klik op **Volgende** als alles in orde is. De virtuele chirurgische boormal wordt gegenereerd.
3. Inspecteer de virtuele chirurgische boormal.
4. Klik op **Voltooien**.
5. Het dialoogvenster **Plan goedkeuren voor bestelling** wordt weergegeven. Lees die zorgvuldig door. Klik op **Ik heb het bovenstaande gelezen en ga ermee akkoord** om te bevestigen dat u de berichten hebt gelezen, en dat alles is zoals zou moeten.
6. Klik op **Bestelling maken** om de boormal direct te bestellen. Het systeem leidt u naar de bestelmodule, toont het planningsbestand en maakt het mogelijk dat u producten kunt bestellen. Als u uw bestelling wilt uitstellen, klikt u op **Later goedkeuren**.

**Opmerking:** De kleur van een virtuele chirurgische boormal voor lokale productie verschilt van de kleur van een virtuele chirurgische boormal die wordt geproduceerd door Nobel Biocare.



Virtuele boormal berekend voor productie door Nobel Biocare.



Virtuele boormal berekend voor lokale productie.

## De chirurgische boormal inspecteren

Bij het voltooien van een behandelplan is het van groot belang een aantal zaken te controleren die zouden kunnen verhinderen dat de chirurgische boormal goed wordt gemaakt:

1. Controleer de positie van de ankerpinnen.
2. Controleer de hoeken tussen de implantaten en bespreek bij twijfel met uw team of de hoek de prothetische behandeling niet in gevaar brengt.
3. Controleer de guided sleeves ten opzichte van de aangrenzende tanden.
  - Zorg ervoor dat de sleeve de aangrenzende tanden niet raakt.
  - Controleer de 3D-weergave om te zien of de chirurgische boormal al dan niet de aangrenzende tanden raakt. Dit om te bepalen of de boormal eventueel moet worden bijgeslepen of aangepast.
4. Controleer elk implantaat in de verticale reslice en in de 3D-weergave om de planning te verifiëren.
5. Controleer de ondersteunende structuren van de chirurgische boormal die rond de sleeves van de implantaten of ankerpinnen zit, op breuken of gaatjes.
6. Communiceer het plan naar het team om alle aspecten te controleren.

### De virtuele chirurgische boormal bewerken

**Opmerking:** Dit is alleen mogelijk voor sjablonen die zijn gemaakt op basis van een optische scan.

Als de virtuele boormal niet op de juiste manier op de gebitscurve is geplaatst (gelijkmatig over het labiale/ buccale en linguale oppervlak), kunt u de vorm van de boormal aanpassen. Wijzig de vorm van de blauwe lijn in de wizard **Boormal bewerken** zodat de curve van de lijn overeenkomt met de gebitscurve.

1. Klik op **Boormal bewerken** op het tabblad **Voltooien**.
2. Klik en sleep de punten op de boog om de positie van de lijn te wijzigen.
3. Wanneer de positie van de blauwe lijn beter overeenkomt met de gebitsboog, klikt u op **Voltooien**.
4. De virtuele chirurgische boormal wordt opnieuw gegenereerd.

Als de vorm van de virtuele boormal nog steeds niet optimaal is, voert u deze stappen nogmaals uit totdat de pasvorm wel optimaal is.

**Opmerking:** In de Verenigde Staten, en een aantal andere markten, is de fysieke chirurgische boormal voor enossale tandheelkundige implantatie een medisch instrument. Neem contact op met uw lokale regulerende instantie voor meer informatie over de wettelijke statussen en vereisten met betrekking tot de productie van deze chirurgische boormal.

### EEN BEHANDELPLAN GOEDKEUREN

Wanneer een behandeling volledig is afgerond, kunt u deze vergrendelen door haar goed te keuren. Lees de tekst in het dialoogvenster **Goedkeuren** door en ga ermee akkoord om verder te gaan met de goedkeuring. De status 'goedgekeurd' verschijnt in de statusbalk Planning.

Een goedgekeurd behandelplan kan niet meer worden gewijzigd. Als u een plan wilt afkeuren en nog meer wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u op de knop **Plan afkeuren**.

# Bestellingen

Verzend een scan of TempShell-bestellingen naar het tandtechnisch laboratorium om een scan uit te voeren of om een tijdelijke TempShell te ontwerpen en te berekenen. Als u de bestellingen via de cloudservice wilt versturen, moet het tandtechnisch laboratorium DTX Studio™ Lab gebruiken en moet er een verbinding tot stand worden gebracht in DTX Studio™ Lab en DTX Studio™ Implant.

## WERKEN MET CONNECTIES

Als u een connectie wilt toevoegen, hebt u het negencijferig identificatienummer van de persoon, de praktijk of het tandtechnisch laboratorium nodig waarmee u een connectie wilt maken. In DTX Studio™ Implant wordt het connectietoken weergegeven in het dialoogvenster **Account beheren**. In DTX Studio™ Lab wordt het connectietoken weergegeven in het dialoogvenster **Accountgegevens**.


### Een connectie toevoegen

Als u een connectie wilt toevoegen:

1. Klik op **Connectie toevoegen**  op het tabblad **Medische dossiers** in de taakbalk **Mijn kantoor**. U kunt ook op het tabblad **DTX Studio Implant** en vervolgens op **Account beheren** klikken.
2. In het dialoogvenster **Beheren** klikt u op **Een nieuwe connectie toevoegen** in de groep **Connecties beheren**.
3. Voer het negencijferig identificatienummer van de account in waarmee u een connectie wilt maken.
4. Klik op **Connectie toevoegen**. De nieuwe connectie wordt toegevoegd aan de lijst met daarin de status **Uitnodiging verzonden**, als er een uitnodiging via e-mail is verzonden naar het adres dat aan de account is gekoppeld.
5. Klik op **OK**.
6. Wanneer uw uitnodiging door de connectie wordt geaccepteerd, krijgt u een e-mail met bevestiging en wordt de status in de lijst gewijzigd in **Geaccepteerd**.

### Een connectie accepteren

Nieuwe verzoeken tot connectie hebben de status **Aangevraagd**. Als u een connectieverzoek wilt accepteren, klikt u op **Accepteren** in de e-mail met de uitnodiging. Andere mogelijkheid:

1. Klik op **Connectie toevoegen**  op het tabblad **Medische dossiers** in de taakbalk **Mijn kantoor** of klik op het tabblad **DTX Studio Implant** en vervolgens op **Account beheren**.
2. In het dialoogvenster **Beheren** selecteert u in de groep **Connecties beheren** het connectieverzoek dat wordt gemarkeerd met de status **Uitnodiging verzonden**.
3. Klik op **Geselecteerde connectie accepteren**.
4. De connectiestatus wordt gewijzigd in **Geaccepteerd** en een e-mail met bevestiging wordt naar de uitnodiger verzonden.

## WERKEN MET BESTELLINGEN

### Productbestellingen


#### Een productbestelling maken

Voor Nobel Biocare-producten kan een productbestelling worden gemaakt. Voor producten die niet van Nobel Biocare zijn (bijvoorbeeld, implantaten van derden), is het niet mogelijk om een productbestelling te maken.

Als u een productbestelling wilt maken:

1. Klik op **Bestellen**  op het tabblad **Voltooien** in de taakbalk **Planning**. Of klik op **Product** in de taakbalk van de module **Bestellen**.

- De lijst met beschikbare planningsbestanden voor de huidige patiënt wordt weergegeven. Bekijk in het rechterdeelvenster de gegevens van het geselecteerde planningsbestand, kies het juiste planningsbestand en klik op **Volgende**.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het planningsbestand dat u wilt bestellen, goedgekeurd is . Alleen goedgekeurde planningsbestanden kunnen worden omgezet in bestellingen. Als een planningsbestand nog niet is goedgekeurd, wordt een waarschuwing weergegeven.

- De **Productlijst** wordt weergegeven. Schakel de vinkjes voor de items op de lijst uit die niet hoeven te worden besteld of pas de hoeveelheden van de te bestellen producten aan en klik op **Volgende**.
- Selecteer het **Verzenden naar**-adres, vul in wie de bestelling heeft geplaatst en voer, indien nodig, opmerkingen voor de productie in.
- Kies tussen **Alleen opslaan** van de bestelling of **Opslaan en nu versturen**.
- Controleer de producten die moeten worden besteld in het deelvenster **Bestelde producten**.
- Klik op **Voltooien**. De bestelling wordt gemaakt en weergegeven in de lijst met gemaakte bestellingen.

#### Een productbestelling verzenden



Als u een gemaakte productbestelling wilt verzenden:

- Selecteer de gemaakte bestelling in de lijst.
- Klik op **Verzenden**  in de taakbalk.

#### Modelscanbestellingen

Als u een oppervlaktescan van het gietmodel, een diagnostische opstelling of waspas en/of een antagonistscan wilt ontvangen, moet u een modelscanbestelling naar het tandtechnisch laboratorium verzenden.

#### Een modelscanbestelling maken

- Klik in de module **Kantoor** op **Nieuw**  en op **Een modelscan bestellen** . Of ga naar de module **Bestellen** en klik op **Scan**.
- Geef de scanobjecten op de tandenkaart aan door te slepen over het gebied dat moet worden gescand en de vereiste optie uit het pop-upmenu te selecteren. De vereiste scans worden in de lijst aan de rechterkant getoond.
- Klik op **Volgende**.
- Kies het aangesloten tandtechnisch laboratorium dat het gietmodel voor u zal scannen, voer alle benodigde gegevens en speciale instructies in, en controleer de lijst met aangevraagde scans.
- Klik op **Voltooien**.
- De modelscanbestelling wordt verzonden naar het tandtechnisch laboratorium en toegevoegd aan de lijst **Bestellingen** en weergegeven met het bestelnummer dat van de server is opgehaald.

#### TempShell -bestellingen

Met onmiddellijke tijdelijke implantaten kan een patiënt een tijdelijke kroon of brug krijgen tijdens de afspraak voor de plaatsing van het implantaat. Daarvoor moeten de DTX Studio™ Implant-gebruiker en het tandtechnisch laboratorium (waar DTX Studio™ Lab wordt gebruikt) samenwerken om een TempShell te maken die door de arts bij de ingreep kan worden omgezet in een tijdelijk implantaat.

#### De TempShell-behandelstappen


De DTX Studio™ Implant-gebruiker maakt een patiëntbestand, voegt prothetische informatie toe en plant de implantaten in. Er wordt een TempShell-bestelling gemaakt en verzonden naar het tandtechnisch laboratorium, dat een verzoek in DTX Studio™ Lab ontvangt. Het tandtechnische laboratorium ontwerpt een LabDesign in DTX Studio™ Lab.

Het LabDesign kan ook worden gedeeld met de DTX Studio™ Implant-gebruiker. Om te controleren of het ontwerp in het behandelplan past, voegt de gebruiker het LabDesign aan het behandelplan in DTX Studio™ Implant toe. Als aanpassingen nodig zijn, wordt voor het doorvoeren van die aanpassingen (telefonisch of via e-mail) contact opgenomen met het tandtechnisch laboratorium. Meerdere contactmomenten tussen de gebruiker van DTX Studio™ Implant en het tandtechnisch laboratorium zijn wellicht nodig. Wanneer de arts bevestigt dat het ontwerp past, wordt de TempShell gemaakt en gedeeld door het tandtechnisch laboratorium.

De DTX Studio™ Implant-gebruiker voegt de TempShell toe aan het behandelplan.


### Een LabDesign-aanvraag maken

Een LabDesign aanvragen:

1. Klik op **LabDesign**  in de taakbalk van de module **Bestellen**.
2. De lijst met beschikbare planningsbestanden voor de huidige patiënt wordt weergegeven. Bekijk in het rechterdeelvenster de gegevens van het geselecteerde planningsbestand, kies het juiste planningsbestand en klik op **Volgende**.
3. Het **overzicht met de LabDesign-aanvraag** wordt weergegeven.
4. Geef op de tandenkaart de posities aan waarvoor een LabDesign (een restauratie of brug) is aangevraagd.
5. Selecteer het tandtechnisch laboratorium dat de aanvraag zal verwerken of kies ervoor om de bestelling als een bestand te exporteren.
6. Controleer de aanvraag en pas die zo nodig aan.
7. Klik op **Voltooien**.


### Een TempShell-bestelling maken

Als u een TempShell-bestelling wilt maken en die naar het tandtechnisch laboratorium wilt sturen:

1. Klik op **TempShell**  in de taakbalk van de module **Bestellen**.
2. De lijst met beschikbare planningsbestanden voor de huidige patiënt wordt weergegeven. Bekijk in het rechterdeelvenster de gegevens van het geselecteerde planningsbestand, kies het juiste planningsbestand en klik op **Volgende**.
3. Het **TempShell-besteloverzicht** wordt weergegeven.
4. Geef op de tandenkaart de posities aan waarvoor een TempShell (een restauratie of brug) wordt besteld. Selecteer de uitbreiding van de vleugels niet.
5. Selecteer het tandtechnisch laboratorium dat de bestelling zal verwerken of kies ervoor om de bestelling als een bestand te exporteren.
6. Controleer de bestelling en pas die zo nodig aan.
7. Klik op **Voltooien**.

### Een LabDesign toevoegen aan het behandelplan


Als u wilt controleren of de restauratie die door het tandtechnisch laboratorium is ontworpen in het behandelplan past, kan het gedeelde LabDesign worden toegevoegd aan het behandelplan.

1. Klik op **LabDesign toevoegen**  op het tabblad **Prothetiek** van de module **Planning**.
2. Het dialoogvenster **LabDesign toevoegen** wordt weergegeven. Selecteer het **LabDesign** en klik op **LabDesign toevoegen**.
3. Het **LabDesign** wordt toegevoegd aan de weergave.
4. Neem telefonisch of via e-mail contact op met het tandtechnisch laboratorium om na te gaan of het LabDesign past of om wijzigingen aan te vragen.

### Opmerkingen:

- Als u het behandelplan moet aanpassen, plaats dan wel opnieuw een bestelling voor de LabDesign.
- Als er een LabDesign-bestand op een schijf staat, importeer dat dan met de actie **LabDesign importeren** in het dialoogvenster **LabDesign toevoegen**.

### Een TempShell toevoegen aan het behandelplan

1. Klik op **TempShell**  op het tabblad **Voltooien** in de taakbalk **Planning**.
2. Het dialoogvenster **TempShell toevoegen** wordt weergegeven.
3. Klik op een beschikbare TempShell die moet worden toegevoegd aan het behandelplan.
4. Klik op **TempShell Toevoegen**.



**Opmerking:** Als er een TempShell-bestand op een schijf staat, importeer dat dan met de optie **TempShell importeren** in het dialoogvenster **TempShell toevoegen**.

## Serviceaanvragen

### De gangbare behandelstappen voor de serviceaanvraag via DTX Studio™ Go

De DTX Studio™ Clinic-gebruiker (aanvrager) wil graag van een DTX Studio™ Implant-gebruiker (de aanbieder) een plan voor een specifieke casus ontvangen. De aanvrager maakt een patiëntbestand in DTX Studio™ Clinic en vervolgens wordt er een serviceaanvraag verzonden via DTX Studio™ Go. Wanneer de aanbieder een nieuwe aanvraag in DTX Studio™ Go ontvangt om een plan te maken, kunnen de benodigde bestanden worden gedownload. Het zipbestand moet worden uitgepakt en opgeslagen. De aanbieder maakt een nieuw patiëntbestand in DTX Studio™ Implant en gebruikt de ontvangen patiëntgegevens als invoer. De aanbieder voert de normale stappen voor het plannen van het implantaat uit in DTX Studio™ Implant en keurt het behandelplan goed. Vervolgens kan hij of zij op de serviceaanvraag reageren en het behandelplan via DTX Studio™ Go naar de aanvrager terugsturen.

### Reageren op een serviceaanvraag

Ga als volgt te werk om een goedgekeurd plan terug te sturen naar de serviceaanvrager:

1. Klik in de module **Bestellen** op **Aanvraag beantwoorden** .
2. Selecteer het juiste plan in de lijst. Klik op **Volgende**.
3. Vul de vereiste gegevens in om de serviceaanvraag aan te passen. Zorg dat u het rapport bijvoegt en, optioneel, aantekeningen of afbeeldingen toevoegt.
4. Klik op **Voltooien**.
5. In een pop-upvenster worden basisgegevens zoals service-id en gegevens van de aanvrager weergegeven, zodat u kunt controleren of de behandeling voor de juiste patiëntcasus wordt teruggestuurd. Klik op **Uploaden** om het plan naar de aanvrager te sturen.

### De 'lokale' behandelstappen voor de serviceaanvraag

Als een gebruiker zowel DTX Studio™ Clinic als DTX Studio™ Implant op één computer heeft geïnstalleerd, wijken de behandelstappen enigszins af. Er wordt in DTX Studio™ Clinic een patiëntbestand gemaakt en de benodigde uitlijningen worden uitgevoerd om een patiëntmodel te maken. Wanneer DTX Studio™ Implant vanuit DTX Studio™ Clinic wordt geopend, wordt het patiëntmodel geëxporteerd en wordt er op basis van de geëxporteerde gegevens een nieuw patiëntbestand in DTX Studio™ Implant gemaakt. Het behandelplan voor het implantaat wordt gemaakt in DTX Studio™ Implant en kan worden geëxporteerd naar en rechtstreeks worden gevisualiseerd in DTX Studio™ Clinic.



**Belangrijk:** wanneer de uitlijning van de optische scan en het patiëntmodel in DTX Studio™ Clinic is uitgevoerd via SmartFusion™, verschijnt er een waarschuwingsbericht waarin u wordt gevraagd om de uitlijning te controleren:

**Controleer de uitlijning van de optische scan en het patiëntmodel en als dit onjuist is of als u twijfelt, kunt u de uitlijning opnieuw berekenen in de wizard Optische scan bewerken.**

Als zowel DTX Studio™ Clinic als DTX Studio™ Implant op één computer is geïnstalleerd, moet het goedgekeurde plan worden geëxporteerd.




1. Klik in de module **Bestellen** op **Aanvraag uitvoeren** .
2. Selecteer het juiste plan in de lijst. Klik op **Volgende**.
3. Vul de vereiste gegevens in om de serviceaanvraag aan te passen. Zorg dat u het rapport bijvoegt en, optioneel, aantekeningen of afbeeldingen toevoegt.
4. Klik op **Exporteren**.
5. Kies de locatie waar u de geëxporteerde bestanden wilt opslaan. Klik op **Map selecteren**.
6. De bestanden zijn nu beschikbaar op de geselecteerde locatie.



# Werken met de DTX Studio™ Implant Assistent

U opent de DTX Studio™ Implant Assistent door te klikken op **Assistent** rechtsboven in het venster.

Het venster **DTX Studio™ Implant Assistent** wordt weergegeven. De DTX Studio™ Implant Assistent bestaat uit verschillende tabbladen:

- **Taken** : via een overzicht van planning en aanvullende taken wordt u door de planningsprocedure geleid.
- **Waarschuwingen** : waarschuwingsberichten stellen u op de hoogte van mogelijke problemen.
- **Overzicht planning** : er wordt een overzicht gegeven van de implantaten, abutments en/of ankerpinnen die in het behandelplan worden gebruikt. Ook wordt aangegeven of de scanprothese en chirurgische boormal zijn gemaakt. De positie van de geplande implantaten wordt aangegeven op de tandenkaart.

Assistent


Warnings (4)


SUPERSEDED

# DTX Studio™ Implant-waarschuwingssysteem

Een aantal technische/aan productie gerelateerde/procedurele waarschuwingen (bijv. guided sleeves te dicht op elkaar geplaatst, geen ankerpinnen geplaatst, implantaat te dicht op een aangeduide zenuw gepland) worden in de DTX Studio™ Implant-software gevisualiseerd.

Wanneer er waarschuwingen worden gegenereerd omdat er door DTX Studio™ Implant klinische of technische planningsproblemen zijn gedetecteerd, kunt u deze bekijken in het gedeelte **Waarschuwingen** in de Planningsassistent.

Open de Planningsassistent en klik op **Waarschuwingen**  of klik op **Waarschuwingen** onder de knop **Assistent**. De Planningassistent geeft de waarschuwingen weer, ingedeeld in klinische en boormalwaarschuwingen.

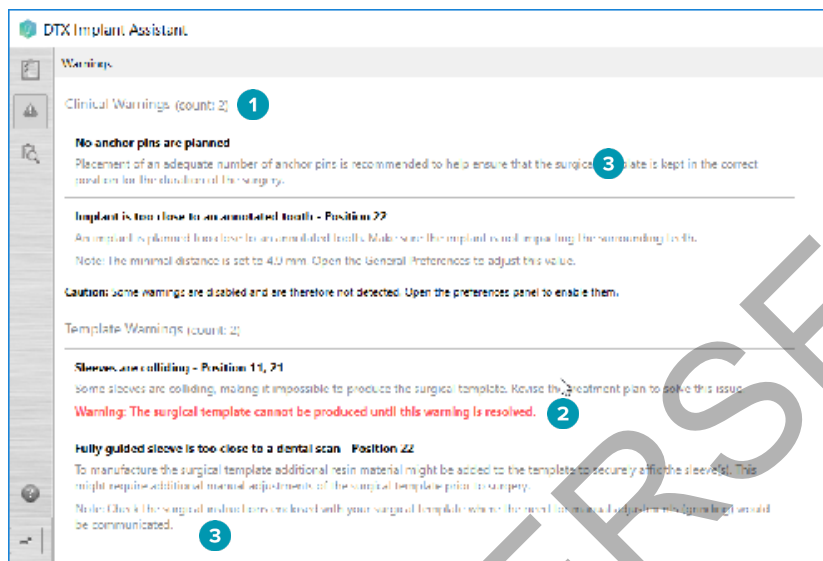

- 1 Het aantal actuele klinische en boormalwaarschuwingen wordt weergegeven in de kop met het type waarschuwing.
- 2 Wanneer er geen chirurgische boormal kan worden geproduceerd, zijn de specifieke waarschuwingen gemarkeerd met een rode melding, met de vermelding dat de waarschuwingen moeten worden opgelost voordat de chirurgische boormal kan worden geproduceerd.
- 3 Configureerbare waarschuwingen worden begeleid door een opmerking met een vermelding van de instelwaarde en waar deze waarde kan worden gewijzigd voor het geval dat iets moet worden aangepast. Als een configureerbare waarschuwing is uitgeschakeld, wordt een waarschuwing melding weergegeven om u te laten weten dat mogelijke problemen wellicht niet zijn gedetecteerd.

## DTX STUDIO™ IMPLANT-WAARSCHUWINGEN

### Waarschuwing



Dit planningsprogramma controleert niet automatisch alle technische beperkingen. In sommige gevallen kunnen chirurgische sjablonen zelfs niet worden geproduceerd als technische beperkingen niet automatisch worden aangegeven via de software.

Tijdens het plannen moet rekening worden gehouden met bepaalde technische beperkingen om ervoor te zorgen dat het chirurgisch boormal correct wordt geproduceerd en dat de gemaakte boormal tijdens de ingreep goed kan worden gebruikt. Door DTX Studio™ Implant worden automatisch de mogelijke schendingen van een aantal technische en klinische beperkingen aangegeven. Wanneer bepaalde beperkingen worden overschreden, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven in de Assistent. Klik op dit bericht om de gedetailleerde beschrijving van de opmerkingen en waarschuwingen te bekijken.

In de 2D- en 3D-viewer worden objecten die een probleem veroorzaken, rood of oranje, afhankelijk van het type overtreding. De bijbehorende waarschuwingsberichten worden weergegeven in de Assistent. Deze berichten zijn ook zichtbaar in het venster **Goedkeuren**, het planningsoverzicht, het rapport, enzovoort.

Hieronder staat een overzicht van de mogelijke waarschuwingen volgens het type waarschuwing.

### Boormalwaarschuwingen

In het rapport worden de boormalwaarschuwingen op de laatste pagina getoond.

Waarschuwing	Uitleg
Sleeves komen met elkaar in botsing.*	Sommige sleeves komen met elkaar in botsing, waardoor de chirurgische boormal niet kan worden geproduceerd. Herzie het behandelplan om dit probleem op te lossen.
Een implantaat en een sleeve komen met elkaar in botsing.	Een implantaat komt in botsing met een sleeve. Dit kan tijdens de ingreep tot problemen leiden. Herziening van het behandelplan wordt aanbevolen.
Ankerpin en sleeve komen met elkaar in botsing.	Een ankerpin komt in botsing met een sleeve. Dit kan tijdens de ingreep tot problemen leiden. Herziening van het behandelplan wordt aanbevolen.
Geannoteerde tand en sleeve komen met elkaar in botsing.	Een sleeve komt in botsing met een geannoteerde tand. Zorg ervoor dat deze botsing de juiste plaatsing van de chirurgische boormal niet hindert.
Ankerpin staat te dicht bij de optische scan.	Een ankerpin sleeve is te dicht bij de optische scan gepland. Dit kan fouten veroorzaken bij de juiste plaatsing van de chirurgische boormal tijdens de ingreep. Probeer de sleeve van de ankerpin zo te plaatsen dat deze niet in botsing komt met de optische scan.
Pilot sleeve staat te dicht bij de optische scan.*	Een pilot drill sleeve bevindt zich te dicht bij de optische scan waardoor het onmogelijk is om de chirurgische boormal te produceren. Herzie de positie van de geplande implantaten of wijzig de sleeve-verschuiving om het probleem op te lossen.
Een fully-guided sleeve bevindt zich te dicht bij de optische scan.	Voor de productie van de chirurgische boormal moet mogelijk extra kunsthars aan de boormal worden toegevoegd om de sleeve(s) veilig te bevestigen. Dit vereist mogelijk aanvullende handmatige aanpassingen van de chirurgische boormal voorafgaand aan de ingreep. Opmerking: raadpleeg in de chirurgische instructies die zijn meegeleverd met uw chirurgische boormal het gedeelte waarin handmatige aanpassingen (bijslijpen) worden besproken.

\* De chirurgische boormal kan pas worden geproduceerd als deze waarschuwing is opgelost.

## Klinische waarschuwingen

Klinische waarschuwingen zijn onderverdeeld in algemene waarschuwingen en implantaatwaarschuwingen. Klinische waarschuwingen worden getoond op de implantaatpagina's van het rapport.

### Algemene waarschuwingen

Waarschuwing	Uitleg
Er zijn geen ankerpinnen gepland.	Plaatsing van voldoende ankerpinnen wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de chirurgische boormal gedurende de ingreep op de juiste positie wordt gehouden.
Ankerpinnen komen met elkaar in botsing.	Sommige ankerpinnen komen met elkaar in botsing. Dit kan tijdens de ingreep tot problemen leiden. Herziening van het behandelplan wordt aanbevolen.
Scanprothese is niet gekalibreerd.	Het 3D-model van de scanprothese is gemaakt met een grijswaarde (isowaarde) als threshold, die niet is gekalibreerd voor uw scanner. Voor het produceren van een goed passende chirurgische boormal is het belangrijk om de NobelGuide-kalibratieprocedure te volgen, die wordt beschreven in de handleiding van NobelGuide.
Behandeling gepland met niet-geïnstalleerde producten.*	Het behandelplan bevat producten die momenteel niet op uw computer zijn geïnstalleerd. Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en open het behandelplan opnieuw. Neem contact op met de plaatselijke helpdesk als de ontbrekende producten niet kunnen worden geïnstalleerd.
Visualisatie van lage kwaliteit is ingeschakeld.**	Voor het 3D-patiëntmodel wordt een visualisatie van een lage kwaliteit gebruikt in het behandelplan.
De uitlijning van de optische scan is handmatig aangepast.	De uitlijning tussen het patiëntmodel en een optische scan is handmatig aangepast door overeenkomende punten aan te geven of een nieuw optisch scanoppervlak te importeren. Controleer nogmaals of een optische scan correct is uitgelijnd met de (CB) CT-scan, aangezien afwijkingen fouten veroorzaken in de juiste plaatsing van de implantaten.
SmartFusion-uitlijning mislukt.*	De SmartFusion-uitlijning is mislukt en is niet handmatig aangepast. Start de actie Optische scan bewerken om dit probleem op te lossen.
SmartFusion-uitlijning controleren	Controleer de uitlijning van de optische scan met het patiëntmodel en als dit niet correct is of als u twijfelt, herbereken dan de uitlijning in de wizard Optische scan bewerken.

\* De chirurgische boormal kan pas worden geproduceerd als deze waarschuwing is opgelost.

\*\* Weergave bij visualisatie van lage kwaliteit verhoogt het risico dat sommige anatomische kenmerken niet zichtbaar zijn in het patiëntmodel. De instelling zal alleen de kwaliteit van het 3D-volume beïnvloeden. CT-doorsneden worden er niet door beïnvloed.

## Implantaatwaarschuwingen

Sommige van de implantaatwaarschuwingen zijn configureerbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld worden in- of uitgeschakeld en/of de waarden die worden gebruikt om de waarschuwingen te activeren kunnen door de gebruiker worden gedefinieerd. In de tabel hieronder hebben zij het label 'configureerbaar'.



### Belangrijk

De waarden voor activering van de implantaatwaarschuwingen moeten worden ingesteld op basis van de klinische expertise en ervaring van de gebruiker.


Waarschuwing	Uitleg
Implantaten komen met elkaar in botsing.	Sommige implantaten komen met elkaar in botsing. Dit kan tijdens de ingreep tot problemen leiden. Herziening van het behandelplan wordt aanbevolen.
Implantaat en ankerpin komen met elkaar in botsing.	Een implantaat komt in botsing met een ankerpin. Dit kan tijdens de ingreep tot problemen leiden. Herziening van het behandelplan wordt aanbevolen.
Implantaat staat te dicht bij een geannoteerde zenuw.*	Een implantaat is te dicht bij een geannoteerde zenuw gepland. Zorg ervoor dat het implantaat de zenuw niet raakt. Opmerking: de minimale afstand wordt ingesteld op [...] mm. Open de algemene instellingen om deze waarde aan te passen.
Implantaat staat te dicht bij een geannoteerde tand.*	Een implantaat is te dicht bij een geannoteerde tand gepland. Zorg ervoor dat het implantaat de naastgelegen tanden niet raakt. Opmerking: de minimale afstand wordt ingesteld op [...] mm. Open de algemene instellingen om deze waarde aan te passen.

\* Deze waarschuwingen zijn configureerbaar

### Configureerbare waarschuwingen

De configureerbare waarschuwingen zijn gebaseerd op een volume rond het implantaat (d.w.z. het waarschuwingsvolume). Wanneer dit volume tegen een geannoteerde anatomische structuur botst, wordt een waarschuwing afgegeven.

Het waarschuwingsvolume is gebaseerd op een vooraf ingestelde afstand. Standaard is deze afstand ingesteld op 1,5mm, de minimale afstand. Bij deze minimale afstand komt het waarschuwingsvolume overeen met de gele zone (op basis van een afstand van 1,5mm rond het implantaat en een afstand van 2 x 1,5mm (3,0mm) tot de apex). Het waarschuwingsvolume kan worden vergroot. Zoals u in de afbeelding ziet (voor een afstand van bijvoorbeeld 4,0mm) is het waarschuwingsvolume dienovereenkomstig geschaald.

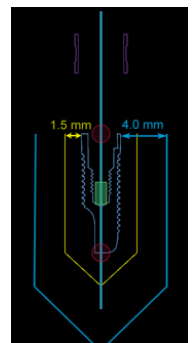

#### Waarschuwing tussen implantaten en zenuwen

Wanneer een implantaat te dicht bij een geannoteerde zenuw wordt geplaatst (d.w.z. dat het waarschuwingsvolume botst met de visualisatie van de geannoteerde zenuw), wordt een waarschuwing afgegeven. Het implantaat in kwestie wordt weergegeven (als het nog niet zichtbaar was) en wordt oranje.

#### Waarschuwing tussen implantaten en tandwortels

Wanneer een implantaat te dicht bij een tandwortel wordt geplaatst (d.w.z. dat het waarschuwingsvolume botst met de geannoteerde tand), wordt een waarschuwing afgegeven. Het implantaat wordt weergegeven en wordt oranje.


**Opmerking:** De minimale afstand van het waarschuwingvolume moet worden ingesteld via **DTX Studio Implant > Algemene instellingen**. De waarden worden opgeslagen op de computer waarop u werkt. Wanneer het behandelplan wordt geopend op een andere computer dan de computer die is gebruikt om het plan te maken, worden de waarschuwingen weergegeven volgens de instellingen van de computer waarop het plan momenteel wordt gebruikt. Dit kan leiden tot verschillende waarschuwingen op basis van de instellingen van de computer. De configureerbare waarden kunnen altijd worden aangepast in de instellingen, en de waarden worden weergegeven in het waarschuwingsoverzicht wanneer een waarschuwing wordt afgegeven.

## TECHNISCHE BEPERKINGEN

Hier volgt uitleg over een aantal technische beperkingen die cruciaal zijn voor de correcte productie van de chirurgische boormal. Indien met deze beperkingen geen rekening wordt gehouden, kan niet worden gegarandeerd dat de chirurgische boormal kan worden gemaakt of dat deze goed kan worden gebruikt.

### Minimale afstand tussen guided sleeves

Voor de chirurgische boormal moet een minimale afstand tussen de guided sleeves in acht worden genomen. Als de afstand te klein is, kan de chirurgische boormal niet worden geproduceerd.




Als de minimale ruimte tussen de guided sleeves wordt overschreden, worden de guided sleeves automatisch zichtbaar en krijgen ze een rode kleur. In deze configuratie kan de chirurgische boormal niet worden geproduceerd.

Deze situatie kan worden opgelost door de implantaten zodanig te verplaatsen of te kantelen dat de ruimte tussen de sleeves groter wordt. Als de afstand groot genoeg is, krijgen de guided sleeves automatisch weer hun normale kleur.

### Minimale afstand tussen guided sleeves en implantaten of guided sleeves en ankerpinnen

Wanneer guided sleeves en implantaten of guided sleeves en ankerpinnen heel dicht bij elkaar staan of met elkaar in botsing komen, worden ze automatisch zichtbaar en krijgen ze een oranje kleur. Een te korte afstand tussen een sleeve en een implantaat of ankerpin kan lastig zijn tijdens de ingreep als een osteotomie moet worden voorbereid of als een implantaat of ankerpin moet worden geplaatst.


Dit probleem kan worden opgelost door de implantaten of ankerpinnen zodanig te verplaatsen of te kantelen dat de ruimte tussen deze elementen en de sleeve groter wordt. Als de afstand groot genoeg is, krijgen ze automatisch weer hun normale kleur.



### Contact tussen implantaten, ankerpinnen, of implantaten en ankerpinnen

Wanneer implantaten onderling, ankerpinnen onderling, of implantaten en ankerpinnen met elkaar in botsing komen, worden ze automatisch zichtbaar en kleuren ze oranje. Botsing van deze objecten kan problemen veroorzaken tijdens de ingreep.

Dit probleem kan worden opgelost door de implantaten of ankerpinnen zodanig te verplaatsen of te kantelen dat ze niet met elkaar in botsing komen. Als de afstand groot genoeg is, krijgen ze automatisch weer hun normale kleur.



**Opmerking:** in sommige gevallen wordt de locatie van het implantaat eerst voor een ankerpin gebruikt. Voordat het implantaat wordt ingebracht, moet de ankerpin worden verwijderd.

## Verhouding tussen guided sleeve en scanprothese en/of optische scan


Tijdens het plannen is het naast alle klinische overwegingen belangrijk rekening te houden met de technische beperkingen voor de positie van de guided sleeves ten opzichte van de scanprothese en/of de optische scan. De positie van de guided sleeves moet worden gecontroleerd terwijl de scanprothese en/of de optische scan zichtbaar is.

### Scanprothese

#### Positie

Elke guided sleeve moet binnen de diagnostische scanprothese worden geplaatst om te zorgen dat in de chirurgische boormal voldoende materiaal aanwezig is om de guided sleeve te ondersteunen.


- 1 Correct geplaatst
- 2 Onjuist geplaatst: de sleeve is te ver geplaatst en is niet vastgemaakt aan de scanprothese.



#### Diepte

Het is noodzakelijk de diepte van de sleeve ten opzichte van de scanprothese te controleren. De sleeve mag het oppervlak aan de zijde van de gingiva (gingiva-oppervlak) niet doordringen om zeker te zijn van de juiste positie van de chirurgische boormal. U kunt de diepte van de sleeve verifiëren door de positie ervan te controleren en de diepte van het implantaat verder af te stellen met het pictogram **Diepte** op de desbetreffende taakbalk. Of als u voor een pilot sleeve hebt gekozen, zou u de verschuiving van de sleeve kunnen aanpassen.

- 1 Correct geplaatst
- 2 Onjuist geplaatst: de sleeve is te diep geplaatst.






### Een scan van het gietmodel

Sleeve-posities na implantaatplanning controleren. De volgende situaties moeten worden opgelost:

#### Lateraal contact

Lateraal contact zijn aanrakingen met aangrenzende tanden/kiezen of mogelijk met zacht weefsel (oppervlaktescan van de intraorale situatie). Bij een botsing controleert u of de positie van het implantaat kan worden gewijzigd zodat er geen botsingswaarschuwing meer wordt gegeven. Als dit niet mogelijk is, probeert u de diameter van de sleeve kleiner te maken of kiest u de optie enkel pilotboren. Ervaren gebruikers kunnen ook gedeelten van de procedure voor guided drilling overslaan en het boorprotocol na verwijdering van de chirurgische boormal afronden met het freehand-protocol. Het implantaat wordt vervolgens met de vrije hand geplaatst.

- 1 Onjuist geplaatst: te dicht bij elkaar of in botsing met aangrenzende tanden/kiezen of zacht weefsel.
- 2 Correct geplaatst: gewijzigde diameter.
- 3 Correct geplaatst: gewijzigd in pilot sleeve.







**Verticaal contact**

Verticaal contact is aanraking met aangrenzende tanden/kiezen of mogelijk zacht weefsel (oppervlaktescan van de intraorale situatie). Als er zich verticaal contact voordoet en u hebt de optie pilotboren gekozen, zou u de verschuiving van de sleeve kunnen aanpassen.

- 1 Onjuist geplaatst.
- 2 Correct geplaatst: sleeve-verschuiving aangepast.

**Verhouding tussen guided sleeve en bot**

Tijdens het plannen is het belangrijk rekening te houden met de technische beperkingen voor de positie van de guided sleeves ten opzichte van het botoppervlak waarin tanden zouden kunnen zitten. Als de guided sleeve in botsing komt met het botoppervlak of de resterende tanden die onderdeel zijn van het botmodel, kan de chirurgische boormal mogelijk niet goed worden bevestigd tijdens de ingreep.

In sommige gevallen kan deze fout echter toelaatbaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de guided sleeve in botsing komt met een tand die vóór de ingreep wordt getrokken of wanneer een guided sleeve in botsing komt met een artefact).

**Guided abutments**

Als gebruik van guided abutments gepland is, moet u controleren of de hoek tussen de meest gehoekte implantaten niet groter is dan 30 graden.

**Scanprothese is gemaakt zonder gekalibreerde isowaarde**

Als een chirurgische boormal moet worden geëxporteerd naar de productie, wordt aangeraden bij het maken van een scanprothesemodel gebruik te maken van de gekalibreerde isowaarde. Als de kalibratieset niet wordt gebruikt, wordt een kalibratiewaarschuwing afgegeven ("Het scanprothesemodel is gemaakt zonder gekalibreerde isowaarde.") om het belang van deze automatische stap te benadrukken.



# Het behandelplan bespreken

Met de module **Overleg** kunt u rapporten, alleen-lezen viewerbestanden en Communicator-presentaties maken.

## RAPPORTEN

### Een rapport maken

Als u een rapport wilt maken:

1. Zorg dat een patiëntbestand is geopend. Klik op **Rapport**  in de groep **Communiceren** op het tabblad **Voltooien** van de planningsmodule.
2. De lijst met planningsbestanden wordt weergegeven. Selecteer het juiste planningsbestand en klik op **Volgende**. De gegevens worden geladen en de rapportpagina's worden gegenereerd.
3. Er worden voorbeeldafbeeldingen van rapportpagina's weergegeven: een overzicht van de beschikbare algemene informatie over de patiënt, de behandeling, de gebruikte scanner, de planningswaarschuwingen, gebruikte producten, afbeeldingen van het chirurgieplan, enzovoort.

**Opmerking:** De voorbeeldafbeeldingen worden met een lagere resolutie gegenereerd dan het uiteindelijke PDF-bestand.

4. Geef het rapport een geschikte naam.
5. Voeg desgewenst een opmerking toe aan het rapport (max. 700 tekens).
6. Pas het rapport aan door de pagina's te selecteren die moeten worden opgenomen: maak de selectie van de pagina's die u uit het rapport wilt verwijderen, ongedaan. De pagina's waarvan de selectie ongedaan gemaakt is, worden grijs weergegeven en niet opgenomen in het definitieve gegenereerde rapport.
7. Maak het rapport desgewenst anoniem.
8. Klik op **Voltooien** om het rapport te maken of op **Annuleren** om de aanvraag te annuleren.
9. Bij het bevestigen wordt een voorbeeld weergegeven met de pagina's die voor het rapport zijn geselecteerd. Blader door de pagina's om ze te controleren.

### Een rapport afdrukken

Als u het gemaakte rapport wilt afdrukken, moet u het rapport exporteren en opslaan als een .pdf-bestand.

1. Selecteer het rapport in de lijst met **Communicatie-items**.
2. Klik op **Exporteren** in de groep **Rapport** op het tabblad **Communicatie** in de taakbalk.
3. Blader naar de locatie waar u het rapport wilt opslaan.
4. Klik op **Opslaan**.
5. Het rapport wordt opgeslagen als een PDF-document. Het rapport wordt standaard geopend, waarna u het document kunt afdrukken.

## VIEWERBESTANDEN

Wanneer DTX Studio™ Implant niet beschikbaar is op de computer van de persoon met wie u het behandelplan wilt bespreken, kan een viewerbestand worden gebruikt om over het behandelplan te communiceren. Een viewerbestand is een versie van het behandelplan dat wordt opgeslagen als een alleen-lezen-bestand dat in DTX Studio™ Implant wordt gemaakt en dat het behandelplan van een specifieke patiënt bevat. Een viewerbestand kan alleen worden geopend als DTX Studio™ Implant Viewer is geïnstalleerd op de computer waarmee u werkt.

### Een viewerbestand maken

As u een viewerbestand wilt maken:

1. Open de module **Overleg**.
2. Klik op **Viewer**  in de groep **Communiceren** op het tabblad **Communicatie**.
3. Selecteer het juiste planningsbestand uit de lijst.
4. Klik op **Volgende**.
5. Vul de viewergegevens in op de pagina voor aanpassingen:
  - Voer een geschikte naam in voor het viewerbestand.
  - Klik op de afbeeldingen die in het viewerbestand moeten worden opgenomen.
  - Geef aan of de CT-beeldgegevens al dan niet moeten worden gecomprimeerd.
  - Als de patiëntgegevens niet gedeeld mogen worden, anonimiseer het bestand dan hier door **Alle patiëntinformatie anonimiseren** te selecteren.
  - Als u het viewerbestand meteen na voltooiing wilt delen, selecteert u het bijbehorende selectievakje.
6. Klik op **Voltooien** om het viewerbestand op te slaan.
7. Het viewerbestand wordt opgeslagen en weergegeven in de lijst **Communicatie-items**. Het dialoogvenster **Een viewer delen** wordt weergegeven.
8. Typ het e-mailadres of gebruik de knop **Contacten** om mensen te selecteren met wie u de viewer wilt delen.
9. Voeg een persoonlijk bericht toe en klik op **Delen**.
10. Een e-mail met een downloadlink wordt verzonden naar de geselecteerde mensen.

### Een viewerbestand openen via DTX Studio™ Implant

1. Dubbelklik op een viewerbestand in de lijst **Communicatie-items**.
2. De DTX Studio™ Implant Viewer-toepassing wordt geopend en het geselecteerde viewerbestand wordt weergegeven.

### Een viewerbestand openen via de downloadlink

Wanneer u een e-mail met een downloadlink naar een viewerbestand hebt ontvangen:

1. Klik op de downloadlink in de e-mail.
2. Het viewerbestand wordt gedownload.
3. Blader naar de locatie waar het gedownloade bestand is opgeslagen en dubbelklik op het opgeslagen viewerbestand.
4. DTX Studio™ Implant Viewer wordt geopend en het viewerbestand wordt weergegeven.

## COMMUNICATOR-PRESENTATIES

Communicator-presentaties geven een overzicht van het behandelplan, en u kunt annotaties maken terwijl u de procedure met de patiënt bespreekt. Communicator-presentaties kunnen worden gebruikt om een tandbehandeling met patiënten en collega's te bespreken. Daarnaast kunnen de presentaties beschikbaar worden gemaakt via de cloud service.

Communicator-presentaties worden naar de cloud geüpload en kunnen worden geraadpleegd met de Communicator iPad®-app.

### Een Communicator-presentatie maken

Als u een Communicator-presentatie wilt maken:


1. Open de module **Overleg**.
2. Klik op **Communicator**  in de groep **Communiceren** op het tabblad **Communicatie**.
3. Selecteer het juiste planningsbestand uit de lijst.
4. Klik op **Volgende**.
5. Vul de gegevens voor de Communicator-presentatie in op de pagina voor aanpassingen:
  - Voer een geschikte naam in voor de presentatie.
  - Neem, indien gewenst, opmerkingen over de presentatie op. Die worden weergegeven in de Communicator-presentatie wanneer die wordt geopend op een iPad®.
  - Geef aan welke afbeeldingen in de presentatie moeten worden opgenomen. Alleen afbeeldingen uit de patiëntbibliotheek mogen worden opgenomen.
  - Als de patiëntgegevens niet gedeeld mogen worden, anonimiseer het bestand dan hier door **Alle patiëntgegevens anonimiseren** te selecteren.
  - Als u de Communicator-presentatie naar de iPad® wilt uploaden wanneer die afgerond is, selecteert u het bijbehorende selectievakje.
6. Klik op **Voltooien**.
7. De Communicator-presentatie wordt opgeslagen en weergegeven in de lijst **Communicatie-item**.

# Een behandelplan voor consulten of chirurgie exporteren

Met DTX Studio™ Implant kunt u het behandelplan exporteren voor gebruik in bijvoorbeeld DTX Studio™ Clinic, X-Guide™ of OsseoCare™ Pro of om dat behandelplan in andere softwareproducten te bekijken.

## EXPORTEREN NAAR DTX STUDIO™ CLINIC

U exporteert als volgt het behandelplan om dat te visualiseren in DTX Studio™ Clinic:

1. Ga naar de module **Planning**.
2. Klik op **Exporteren naar DTX Studio Clinic**  in de groep **chirurgieplan** op het tabblad **Voltooien**.
3. Selecteer de map waarin u het versleutelde .dtxip-bestand met alle nodige informatie over uw behandelplan wilt opslaan.
4. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat het bestand is opgeslagen, evenals de locatie waar het bestand is opgeslagen. Klik op **OK** om dat bericht te sluiten.

## 3D-PLAN EXPORTEREN

U exporteert als volgt het behandelplan om dat te visualiseren in andere softwareproducten:

1. Ga naar de module **Planning**.
2. Klik op **3D-plan exporteren**  in de groep **Communiceren** op het tabblad **Voltooien**.
3. Selecteer de map waarin u het behandelplan wilt opslaan.
4. Klik op **Exporteren**.
5. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat het bestand is opgeslagen, evenals de locatie waar het bestand is opgeslagen. Klik op **OK** om dat bericht te sluiten.

## X-GUIDE™ -CHIRURGIEPLAN

X-Guide™ is een 3D-navigatiesysteem voor implantaten waarmee u het behandelplan voor de patiënt kunt overdragen en interactieve begeleiding kunt geven tijdens de chirurgie.




### Waarschuwing

Houd er rekening mee dat er verschillen in de visualisatie van de gegevens (bijv. viewerstand, kleuren van het object) evenals verschillende waarschuwingen kunnen zijn tussen de DTX Studio™ Implant- en de X-Guide™-software.


### Een X-Guide™-chirurgieplan maken

U maakt als volgt een X-Guide™-chirurgieplan:

6. Klik in de module **Overleg** op **X-Guide**  in de groep **Communiceren**.
7. Selecteer het juiste goedgekeurde planningsbestand uit de lijst.
8. Klik op **Volgende**.
9. Vul de gegevens in op de pagina **Pas de chirurgische setup aan**. Anonimiseer indien nodig.
10. Klik op **Voltooien**.

### Een X-Guide™-chirurgieplan exporteren

U exporteert als volgt een X-Guide™-chirurgieplan:

1. Selecteer in de module **Overleg** een gemaakt **X-Guide™**-chirurgieplan in de lijst met **Communicatie-items**.
2. Klik op **Exporteren**  in de groep **X-Guide** op het tabblad **Communicatie**.



### Waarschuwing

Met DTX Studio™ Implant kunnen alleen ondersteunde implantaten naar X-Guide™ worden geëxporteerd. Niet-ondersteunde implantaten worden niet opgenomen in het X-Guide™-bestand.

3. Klik in het dialoogvenster op **Bladeren** en ga naar de locatie waar het X-Guide™-chirurgiebestand moet zijn opgeslagen.
4. Klik op **Opslaan**.


## OSSEOCARE™ PRO CHIRURGIEPLAN

OsseoCare™ Pro is een boormotor die werkt via Apple's iPad®, zodat het mogelijk is om de volgorde van de behandeling voorafgaand aan de chirurgie te plannen en in te stellen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door tandartsen en chirurgen bij het doorboren van hard en zacht weefsel met de juiste hulpmiddelen.

Een OsseoCare™ Pro-chirurgieplan combineert de opeenvolgende stappen in de volgorde van de behandeling en leidt de arts of chirurg stap voor stap via de iPad®-app door het chirurgieproces.

### Een OsseoCare™ Pro-chirurgieplan maken

U maakt als volgt een OsseoCare™ Pro-chirurgieplan:

1. Klik in de module **Overleg** op **OsseoCare Pro**  in de groep **Communiceren**.
2. Selecteer het juiste goedgekeurde planningsbestand uit de lijst.
3. Klik op **Volgende**.
4. Vul de gegevens in op de pagina **De Communicator-presentatie personaliseren**.
5. Klik op **Voltooien**. Standaard wordt het voltooide chirurgieplan geüpload naar de cloud.
6. Klik op **Ik ga akkoord** op de juridische disclaimer om door te gaan.

# Scannerkalibratie

**Opmerking:** Deze procedure voor het kalibreren van de scanner is alleen nodig voor het maken van een scanprothese.

Teneinde het behandelplan voor de ingreep goed en nauwkeurig over te brengen van de computer naar de patiënt, is het belangrijk om een chirurgische boormal te genereren die net zo nauw aansluit op het omliggende zachte en harde weefsel als de scanprothese. Hiervoor is een nauwkeurige 1:1-kopie vereist op basis van digitalisatie met behulp van een (CB)CT-scanner en moet in de software een virtueel scanprothesemodel worden gemaakt op basis van de scannerafhankelijke instellingen. De identificatie van deze waarde, de zogenaamde 'isowaarde', kan handmatig plaatsvinden door middel van handmatige interactie, of kan automatisch plaatsvinden met een kalibratiescan met het unieke NobelGuide®-kalibratieobject dat met behulp van de juiste instellingen door de scanner is verworven. Het NobelGuide®-kalibratieobject is een object met dezelfde radiolucente eigenschappen als de scanprothese (PMMA) en heeft een nauwkeurig gedefinieerde vorm die door de software wordt herkend. Door de referentiescan (kalibratiescan) automatisch te onderzoeken en deze te vergelijken met de bekende oorspronkelijke vorm, kan door DTX Studio™ Implant automatisch de meest geschikte isowaarde (de **Gekalibreerde isowaarde**) worden bepaald en toegepast voor het extraheren (segmenteren) van de juiste afmetingen en vorm op basis van de scanprothesescan. De software slaat alle scannerspecifieke kalibratiesets op. Voor elke scan van een scanprothese wordt automatisch een geschikte kalibratieset gezocht van de 'bekende' scanners. Als een dergelijke scanner wordt gedetecteerd, wordt de bijbehorende **Gekalibreerde isowaarde** voorgesteld en automatisch toegepast. De isowaarde-editor in de wizard voor scanprothese geeft informatie over de gebruikte kalibratieset, het type scanner dat wordt gebruikt en de gekalibreerde isowaarde.

Als een chirurgische boormal moet worden geëxporteerd naar de productie, wordt aanbevolen bij het maken van een scanprothesemodel gebruik te maken van de gekalibreerde isowaarde. Als de kalibratieset niet wordt gebruikt, wordt een kalibratiewaarschuwing afgegeven (**Het scanprothesemodel is gemaakt zonder gekalibreerde isowaarde.**) om het belang van deze automatische stap te benadrukken.

Als gebruik wordt gemaakt van kalibratie, wordt in de isowaarde-editor **Gekalibreerde isowaarde** weergegeven in plaats van **Isowaarde**. Bij gebruik van een door het systeem gegenereerde kalibratieset wordt **Voorgestelde isowaarde** weergegeven.

## EEN NIEUWE KALIBRATIESET MAKEN

De eerste keer dat beeldgegevens van een bepaalde (CB)CT-scanner en een bepaald protocol worden gebruikt, moet een nieuwe kalibratieset worden gemaakt. Als deze kalibratieset eenmaal opgenomen is, kan hij worden gebruikt voor alle patiënten die met deze beeldvormingsapparatuur worden gescand. Het wordt aanbevolen minstens elke zes maanden een nieuwe kalibratieset te maken of wanneer de beeldvormingsapparatuur is bijgewerkt, er upgrades zijn uitgevoerd of onderhoud is uitgevoerd.

U kunt een nieuwe kalibratieset maken door te klikken op **Nieuw**  in de groep **Kalibratieset** op het tabblad **Scanner** van de module **Mijn kantoor**. De wizard **Kalibratie maken** wordt gestart.

De kalibratiewizard leidt u in drie stappen door de kalibratieprocedure:

1. De DICOM-bestanden voor kalibratie laden
2. Kalibratie-instellingen berekenen
3. De gegevens invullen en de kalibratieset opslaan

# Verklarende symbolenlijst



Lotnummer



Artikelnummer



Waarschuwing



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Bevat of heeft sporen van ftalaat



Productiedatum



Niet opnieuw steriliseren



Niet opnieuw gebruiken



Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Rx Only

Enkel op voorschrift te gebruiken

ID

Patiëntidentificatie



Buiten direct zonlicht bewaren



Droog bewaren



Fabrikant



Medisch hulpmiddel



MR-voorwaardelijk



Niet-steriel



Patiëntnummer



Serienummer



Gesteriliseerd met straling



Te gebruiken vóór

# Index

## Symbolen

1G .....	24
2D .....	18, 20
3D .....	20

## A

Aangezichtsscan.....	29
Bijsnijden.....	29
Toevoegen.....	29
Aan implantaat vastmaken .....	42
Aanmelden .....	14
Twee-factor-authenticatie.....	14
Aanzicht .....	
Boven naar onder.....	18
Caudo-craniaal .....	18
Cranio-caudaal .....	18
Links.....	18
Onder naar boven .....	18
Rechts .....	18
Standaard.....	18
Voor.....	18
Abutment .....	33, 34, 36, 56
Hoek.....	33
Account.....	14, 15
Accounts beheren.....	15
Wisselen van account.....	14
Accounts beheren .....	15
Alt .....	18
Ankerpin .....	39, 40, 41
Antagonist .....	29
Apex .....	34

## B

Beeld bijwerken .....	22
Grootste gedeelte behouden .....	23
Isoleren.....	22
Knippen .....	22
Resetten .....	23
Toevoegen.....	22
Uitschakelen.....	23
Beeld bijwerken, volume toevoegen aan.....	22
Beeld bijwerken, volume wegsnijden uit.....	22
Behandeling.....	12
Behandelpen	
Exporteren.....	60
Beheren .....	12
Bestellen .....	45
Model scannen .....	46
Product.....	45
TempShell.....	46

Besturingspunten .....	21
Bolletjes .....	35
Boogmodus.....	42
Boormalwaarschuwingen.....	51
Botartefacten verwijderen .....	23
Botkamreductie .....	38
Botsing .....	54
Verticaal.....	56

## C

Caudo-craniaal.....	18
Chirurgieplan	
OsseoCare Pro .....	61
X-Guide .....	60
Chirurgietype .....	36
chirurgische boormal	
Inspecteren .....	43
Maken .....	43
Cmd.....	18
Compatibiliteit .....	9
Connecties.....	45
Accepteren.....	45
Toevoegen.....	45
Contexttabblad .....	17
Contourlijn .....	19
Cranio-caudaal.....	18
CT-beeld.....	20
Ctrl .....	18
CT-snede.....	20

## D

Diagnosticeren .....	31
Diagnostische scanprothese .....	40, 55
Diepte.....	55
Positie.....	55
DICOM.....	21
Dwarsdoorsnede van de reslice .....	17

## E

Exporteren	
Naar DTX Studio™ Clinic .....	60
Naar OsseoCare Pro.....	61
Naar X-Guide™ .....	60
Openen.....	60
Export openen .....	60

## G

Gebruiker .....	15
Nieuw.....	15
Goedkeuren .....	44



Gom.....	23	Zoomkader.....	18
Magische .....	23	Mucosa.....	39
<b>H</b>		<b>N</b>	
Hounsfield-eenheid .....	33	Naar een ander implantaat springen .....	42
HU .....	33	<b>O</b>	
<b>I</b>		Omtrek.....	19
Implantaat.....	33, 35	Openen .....	17
Apex .....	34	Optische scan.....	24, 28, 31, 55
Hoek.....	33	Toevoegen.....	25
Implantaatmodus .....	42	OsseoCare Pro	
Oriëntatie wijzigen.....	35	Maken .....	61
Schouderpunt .....	34	Overdrachtsfunctie .....	22
Verplaatsen .....	35	Overzicht .....	22
Interactiemodus.....	18	Overeenkomende punten	
Intraoraal .....	39	Kwadrant.....	27
Isoleren .....	22	Verdeling .....	27
<b>K</b>		Verwijderen van punten voor SmartFusion™ .....	28
Kalibratie.....	62	<b>P</b>	
Klik .....	42	Panmodus.....	18
Klikbalk .....	42	Patiënt	
Klikfunctie		Bewerken .....	23
Restaureren.....	42	Patiëntbestand.....	13
Springen.....	42	Sluiten .....	13
Klinische export.....	60	Patiëntmodel.....	19
Kwadranten .....	27	Planningsscenario .....	12
<b>L</b>		Beheren.....	12
LabDesign .....	47	Positie .....	55
Lateraal contact.....	55	Positie initialiseren .....	27
Level/window .....	20	Praktijksysteem .....	15
2D.....	20	Product	
3D.....	20	Selecteren .....	34
<b>M</b>		Productbestelling.....	45
Magische gom.....	23	Productselectie.....	36
Meten		<b>R</b>	
Afstand.....	33	Rapport	
Grijswaarde .....	33	Maken .....	57
Hoek.....	33	Reslicecurve .....	21
HU .....	33	Rotatiemodus .....	18
Metingen .....	33	<b>S</b>	
Minimale afstand.....	54	Scanner .....	57, 62
Modelscanbestellingen.....	46	Scanwaarschuwingen .....	10
Modus		Selecteren, product .....	34
Interactie .....	18	Serviceaanvraag .....	48
Rotatie.....	18	Reactie .....	48
Vastnemen .....	18	Uitvoeren.....	48
Zoomen .....	18	Shift .....	18

SmartFusion™ .....	27
Initialisatiewizard .....	27
Waarschuwingen .....	28
SmartSetup™ .....	29
Instellingen .....	30

## T

Taakbalk .....	16, 17, 19, 50
Tab .....	18
Dedicated tab .....	17
Tandeloos .....	24, 39
Gedeeltelijk .....	24
Tandenkaart .....	35
Tanden terugtrekken .....	32
Tandnotatiesysteem .....	21
Tandpositie .....	34, 35
Technische beperkingen .....	54
TempShell .....	46
Tolerantie .....	35
Gele zone .....	35
Twee-factor-authenticatie .....	14

## U

Uitlijning .....	26
------------------	----

## V

Verticaal contact .....	56
Vestibulum .....	39
Virtuele tand, opstelling van .....	29
Vlak	
Bot snijden .....	38
Voxel .....	22

## W

Waarschuwing .....	49, 50
Boormalwaarschuwingen .....	51
Configureerbaar .....	50, 53
Wachtwoord .....	14
Weergave-editor .....	19
Werkgebied .....	17

## X

X-Guide™ .....	60
Exporteren .....	60
Maken .....	60

## Z

Zoomkadermodus .....	18
Zoommodus .....	18